

ROMÉTRIE INDUSTRIELLE

S. A. R. L. au capital de 25.440.000 francs — Registre de Commerce : Seine 232.754 B

PYROMÈTRE INDUSTRIEL DE PRÉCISION

Boîtier encastré

TYPE ID

Pour couples thermo-électriques
ou pour Cannes à résistance

Compensation automatique
de la soudure froide
du couple thermo-électrique

Boîtier

en matière moulée noire étanche

Blocage

de l'équipage mobile pour le transport

Mise à zéro

réglable

Pivotage vertical

Aiguille

en couteau

Miroir

de parallaxe

Grande résistance intérieure

Graduation en degrés et en millivolts

Longueur de l'échelle : 150 mm


Double graduation en degrés

sur demande

Montage en saillie. Fourniture de console spéciale

NOTA. — Alimentation du galvanomètre à résistance par : "Groupe d'alimentation" séparé.

Un même "Groupe d'alimentation" peut alimenter à concurrence de 4 Pyromètres.

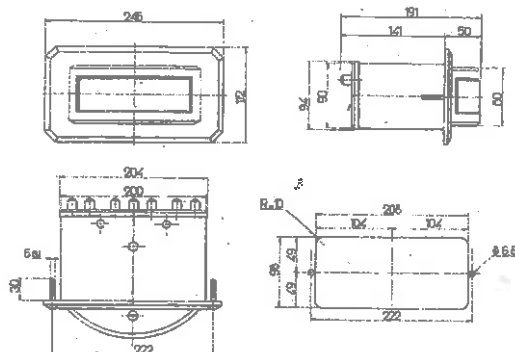

ÉLÉMENTS (suite)

3797. Corps d'autoclave avec agitation et raccords. Corps d'autoclave en acier inoxydable 18/8 Mo avec couvercle à fermeture rapide par filetage trapézoïdal, blocage par quatre vis ; gaine étanche dans le fond pour prise de température. Agitateur à palettes avec double électro-aimant de commande, réfrigérant à eau et tubulure d'insufflation d'air comprimé (pression 150 g/cm², débit 7 m³/heure), raccordement aux fluides par têtes, étagées PROLABO. Coffret de commande d'agitation relié au carter des bobines par câble blindé, comprenant boutons de réglage de la cadence d'agitation, interrupteurs et lampes-témoins ; s'alimente directement sur le secteur 115 V ou 230 V alternatif. Consommation 90 watts (voltage à spécifier). Montées sur la tête d'autoclave, une soupape de sécurité à pastille d'éclatement étalonnée à 300 hpz et une vanne d'arrêt à trois voies surmontée d'un manomètre en bronze, échelle 0-500 hpz.

3614. Régulateur à impulsions Prolabo sous boîtier séparé, se branche sur le câble d'alimentation du four électrique pour régler l'allure de celui-ci.

3786. Pyromètre à couple chromel-alumel, canne pyrométrique coudée s'introduisant dans la gaine inférieure du corps d'autoclave, cordons compensateurs, et indicateur type "profil" à encastrer à large échelle graduée de 0 à 400 °C.


*

3798. Tableau de contrôle équipé d'un **régulateur à impulsions** comprenant sur bâti très robuste et de présentation soignée : pyromètre avec canne pyrométrique coudée, ampèremètre, interrupteur général, fusible de sécurité, interrupteur du chauffage et régulateur à impulsions.

3799. Tableau de contrôle avec régulateur automatique de température à couples thermoélectriques, comprenant sur bâti : pyromètre régulateur avec canne pyrométrique, couple thermoélectrique auxiliaire, lampes-témoins, ampèremètre, interrupteur général, fusibles et interrupteurs du chauffage.

*

3796. Compresseur-ventilateur à moteur électrique, pression 150 g/cm², débit 7 m³/heure, avec raccord pour brancher sur la tétine à air comprimé du carter d'électro-aimant.

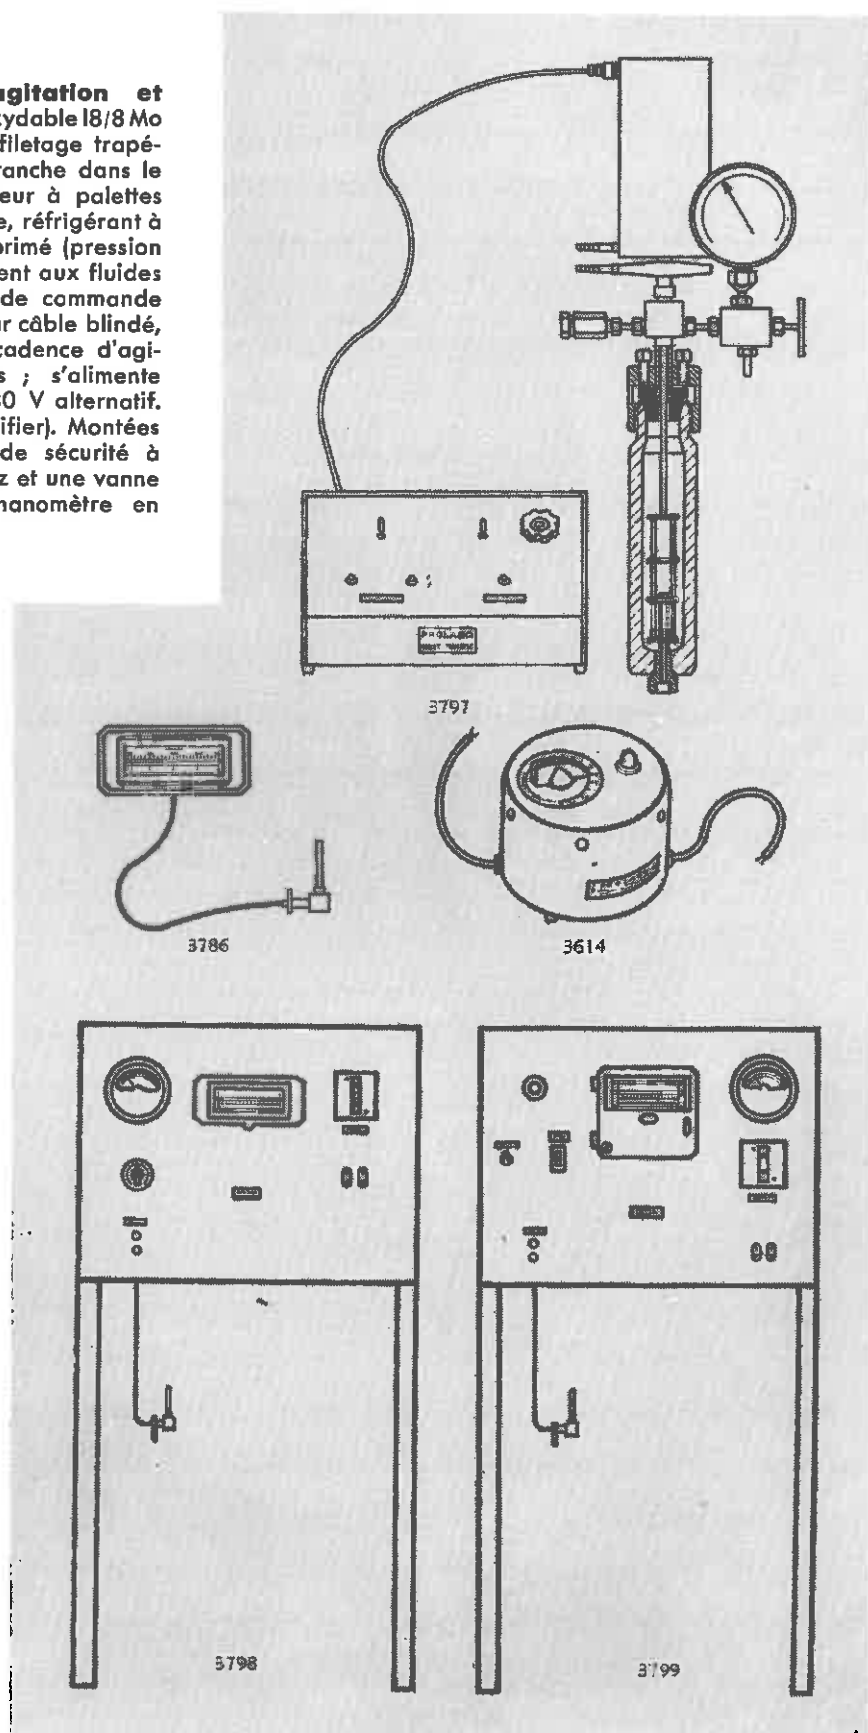**PROLABO**

12, rue Pelée

PARIS-XI^e

49 B

Noter PROLABO RL 1070
(Autoclave pour haute pression)

(42)