

ULTRAMICROSCOPIE

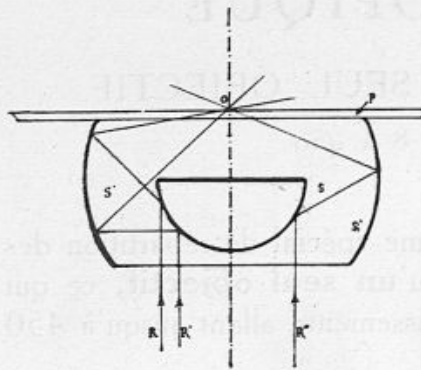


FIGURE 10

40. — Appareil ultramicroscopique. Cet appareil d'éclairage s'emploie sur tous les microscopes, même s'ils ne sont pas de notre fabrication. Il comporte un dispositif de platine mobile facilitant l'examen de la préparation. (Voir figure 11 et figure 10 montrant la marche des rayons.)

L'appareil avec instruction, en écrin 145 fr.

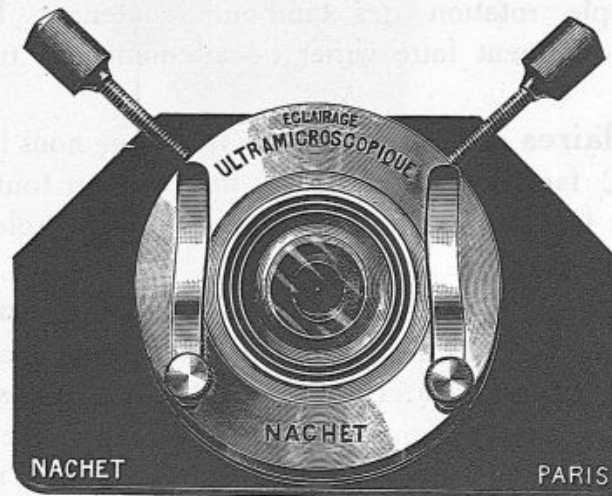


FIGURE 11

40^A — Installation ultramicroscopique avec lampe électrique à condensateur N° 82 et diaphragme de l'objectif, sans microscope. (Indiquer le voltage du courant.) 345 fr.

Même installation avec gaz ou essence 455 fr.

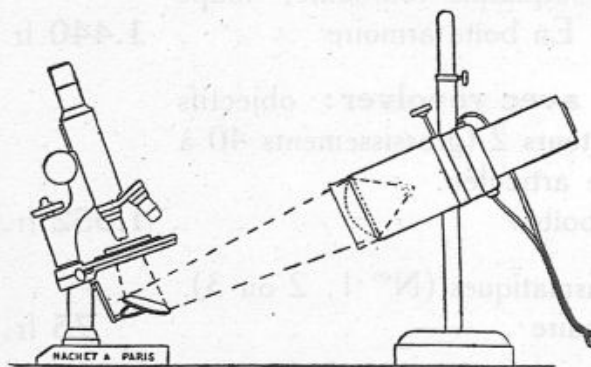


FIGURE 12

40^B — Installation ultramicroscopique avec microscope spécial, lampe électrique, 2 objectifs dont un à immersion et un oculaire.

1.260 fr.