



Fig. 10

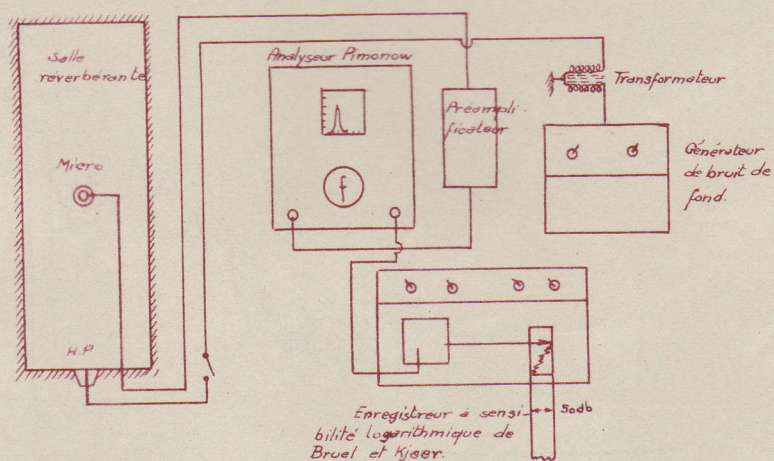

Montage relatif à l'étude de l'influence du spectre de la source complexe sur la réverbération.

Fig. 11

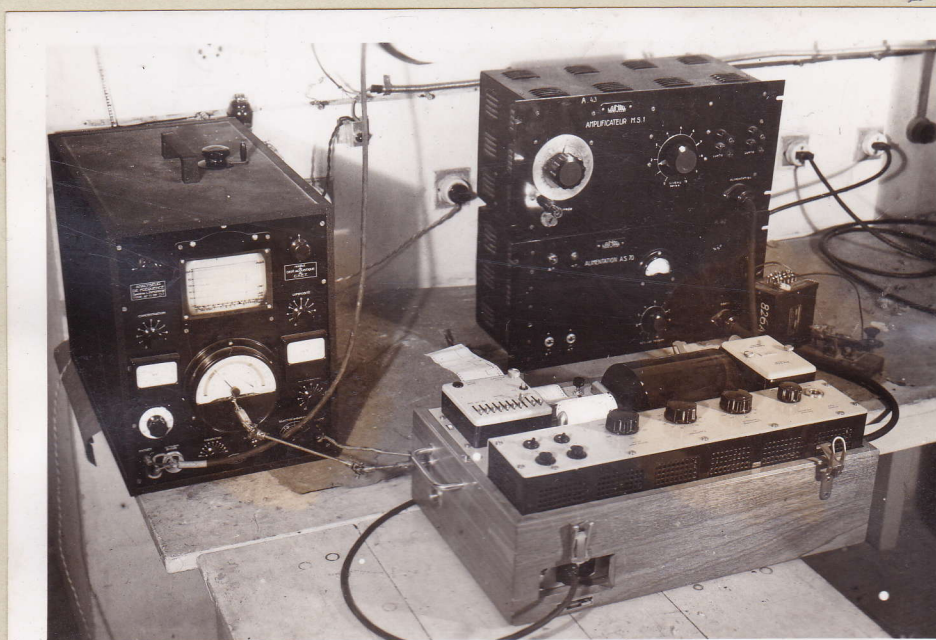

Salle de mesures :
à droite l'oscillateur à battements, à gauche
l'analyseur Pimonow, au centre l'enregistreur de Bruel et Kjaer