

MOTEUR DE LA MACHINE À COULER DES SUPPOSITOIRES

FICHE N° 1202

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : ERWEKA

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d'Angers - UFR Sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé

Ville : Angers

Modèle : AR 400

Matériaux :

Description

Ce moteur AR400 d'ERWEKA de la machine à couler des suppositoires est l'élément de base pour fixer les appareils à brides. L'appareil est équipé d'un moteur à courant continu. Le réglage de la vitesse s'effectue par une commande de rotation électronique pouvant varier de 20 à 400 t/min. Réglage du nombre de tours par minute et la durée du test.


Le panneau frontal comprend un interrupteur d'arrêt d'urgence, une touche ON et OFF, un interrupteur à clé amovible pour sélectionner le mode de fonctionnement, une prise pour tension du réseau, une prise pour verrouillage de sécurité branchement pour interrupteur à pédale, une entrée de la vitesse, une entrée de la durée, un voyant ACL indiquant la vitesse de rotation ainsi que le temps de fonctionnement.

Utilisation

Dans la fabrication de médicaments (galénique), il est utilisé pour la préparation de suppositoires.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER



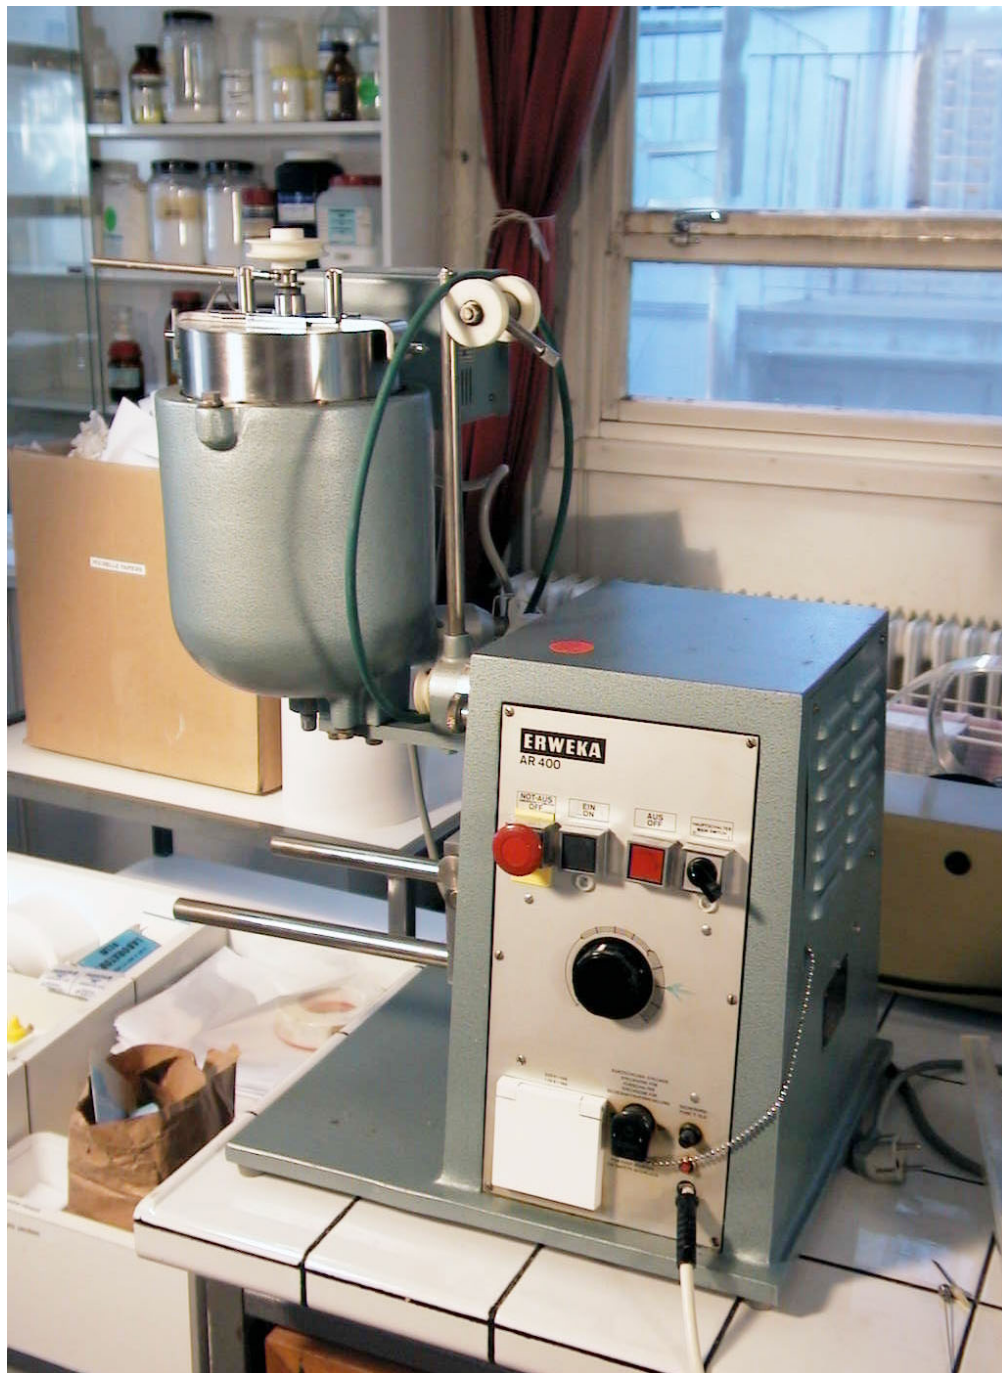

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Moteur de la machine à couler des suppositoires (ERWEKA), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1195>, consulté le 2026-07-22