

CONGÉLATEURS À -80°C THERMO ELECTRON CORPORATION

FICHE N° 8648

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : 706 REL 3

Matériaux :


Description

C'est un congélateur à -80°C Thermo Electron Corporation de taille imposante qui s'ouvre à l'aide d'un système à clef. Le système de commande se trouve dans un boîtier en plastique gris sur lequel se trouvent des boutons de réglages (mode-enter), des voyants lumineux et un cadran à affichage numérique indiquant -79.

Utilisation

Ce congélateur est utilisé pour la conservation des échantillons et des produits.



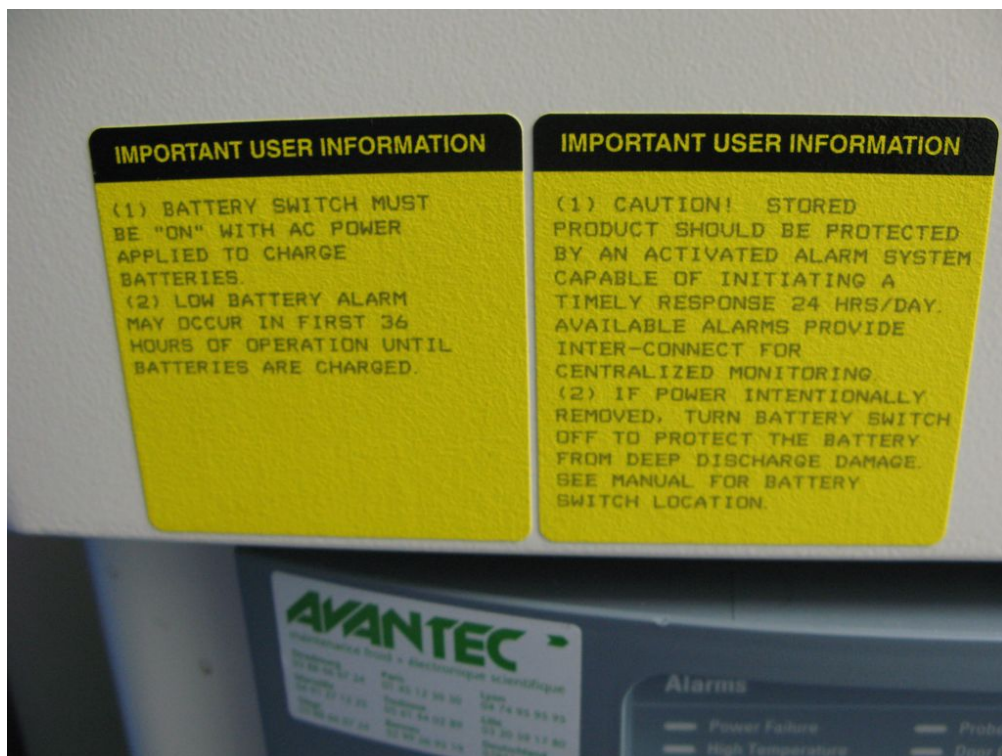

IMPORTANT USER INFORMATION

- (1) BATTERY SWITCH MUST BE "ON" WITH AC POWER APPLIED TO CHARGE BATTERIES.
- (2) LOW BATTERY ALARM MAY OCCUR IN FIRST 36 HOURS OF OPERATION UNTIL BATTERIES ARE CHARGED.

IMPORTANT USER INFORMATION

- (1) CAUTION! STORED PRODUCT SHOULD BE PROTECTED BY AN ACTIVATED ALARM SYSTEM CAPABLE OF INITIATING A TIMELY RESPONSE 24 HRS/DAY. AVAILABLE ALARMS PROVIDE INTER-CONNECT FOR CENTRALIZED MONITORING
- (2) IF POWER INTENTIONALLY REMOVED, TURN BATTERY SWITCH OFF TO PROTECT THE BATTERY FROM DEEP DISCHARGE DAMAGE. SEE MANUAL FOR BATTERY SWITCH LOCATION.

AVANTEC
International Trade & Electronics Scientific

Alarms

- Power Failure
- High Temperature

- Probe
- Door



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Congélateurs à -80°C Thermo Electron Corporation (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13523>, consulté le 2026-07-26