

SERINGUES

FICHE N° 9423

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Les quatre seringues Vetter sont constituées d'une aiguille (biseau, canule et garde), de la seringue (embout et corps comprenant un petit décrochement) et du piston (butoir et poussoir).

Le corps de la seringue contient un liquide et un lyophilisat (en forme de comprimé), séparés par un piston.

Il faut exercer une pression sur le premier piston. Celui-ci pousse le liquide, qui lui-même pousse le deuxième piston. Le comprimé se trouve alors en face du décrochement. Ainsi, lorsque l'on pousse le piston, le liquide de la première chambre passe de l'autre côté, sans que le comprimé ne monte. Quand tout le liquide est monté, le comprimé (lyophilisat) s'est entièrement dissout. On continue à pousser le piston et on met une aiguille sur l'embout de la seringue.



Utilisation

Ces seringues sont destinées à être utilisées dans le cas d'une dissolution instantanée.

Elles permettent d'injecter un principe actif à un patient.

Dans le cas d'une utilisation par les soldats, ceux-ci s'injectent personnellement le principe actif.



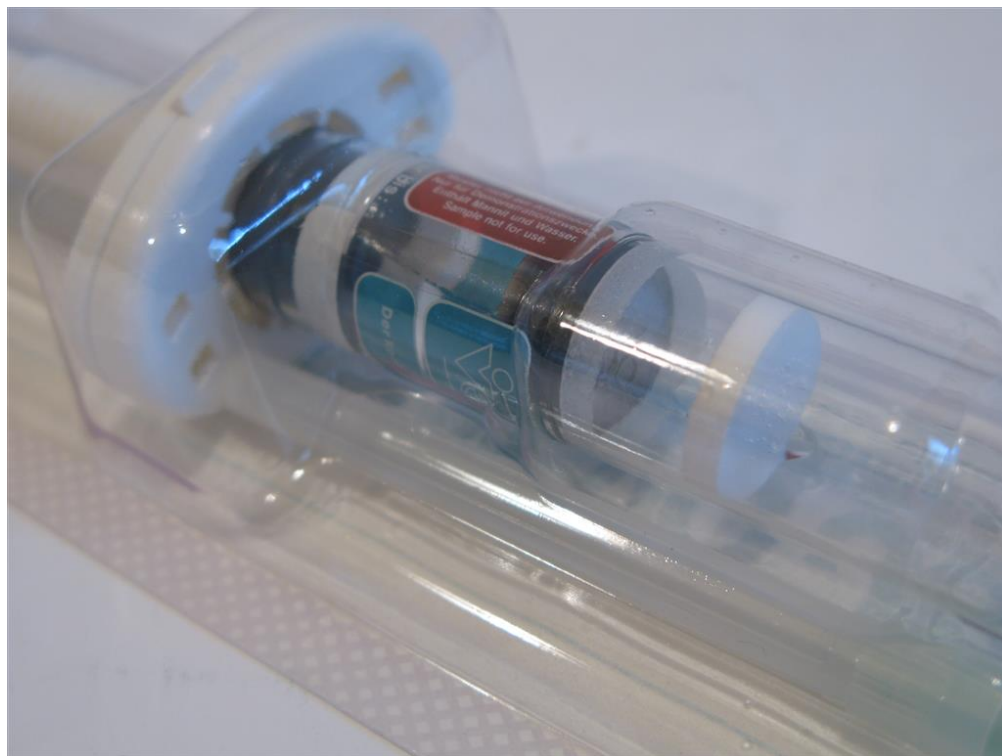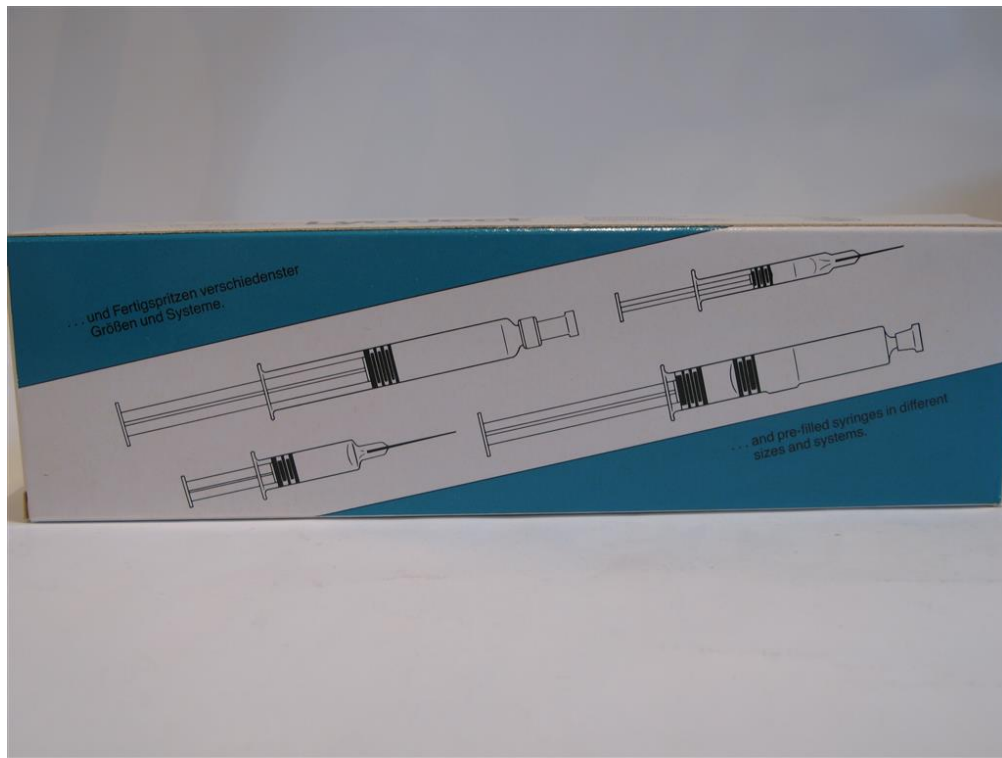





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringues (fabricant non renseigné),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14090>, consulté le 2026-07-27