

## SONOMÈTRE ANALOGIQUE

FICHE N° 9755

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Acoustique

Organisme : Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Ville : Aurillac

Modèle : 840005

Matériaux :

### Description

Le sonomètre analogique Codiam Scientific 84005 se compose d'un boîtier en plastique muni d'un capteur, d'un cadran à aiguille et d'une molette de réglage.

Le cadran est constitué de deux échelles, une haute (80 à 120 décibel) et une basse (40 à 80 décibel).

### Utilisation

L'instrument est un appareil de mesure du niveau de pression acoustique.

Il est utilisé en travaux pratiques lors de la formation des futurs enseignants à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres d'Aurillac.



ETEINT

Echelle BASSE  
(LO)

Echelle HAUTE  
(Hi)

CAL



BATT

SONOMETRE  
ANALOGIQUE  
840005

ETEINT

CODIAM SCIENTIFIC



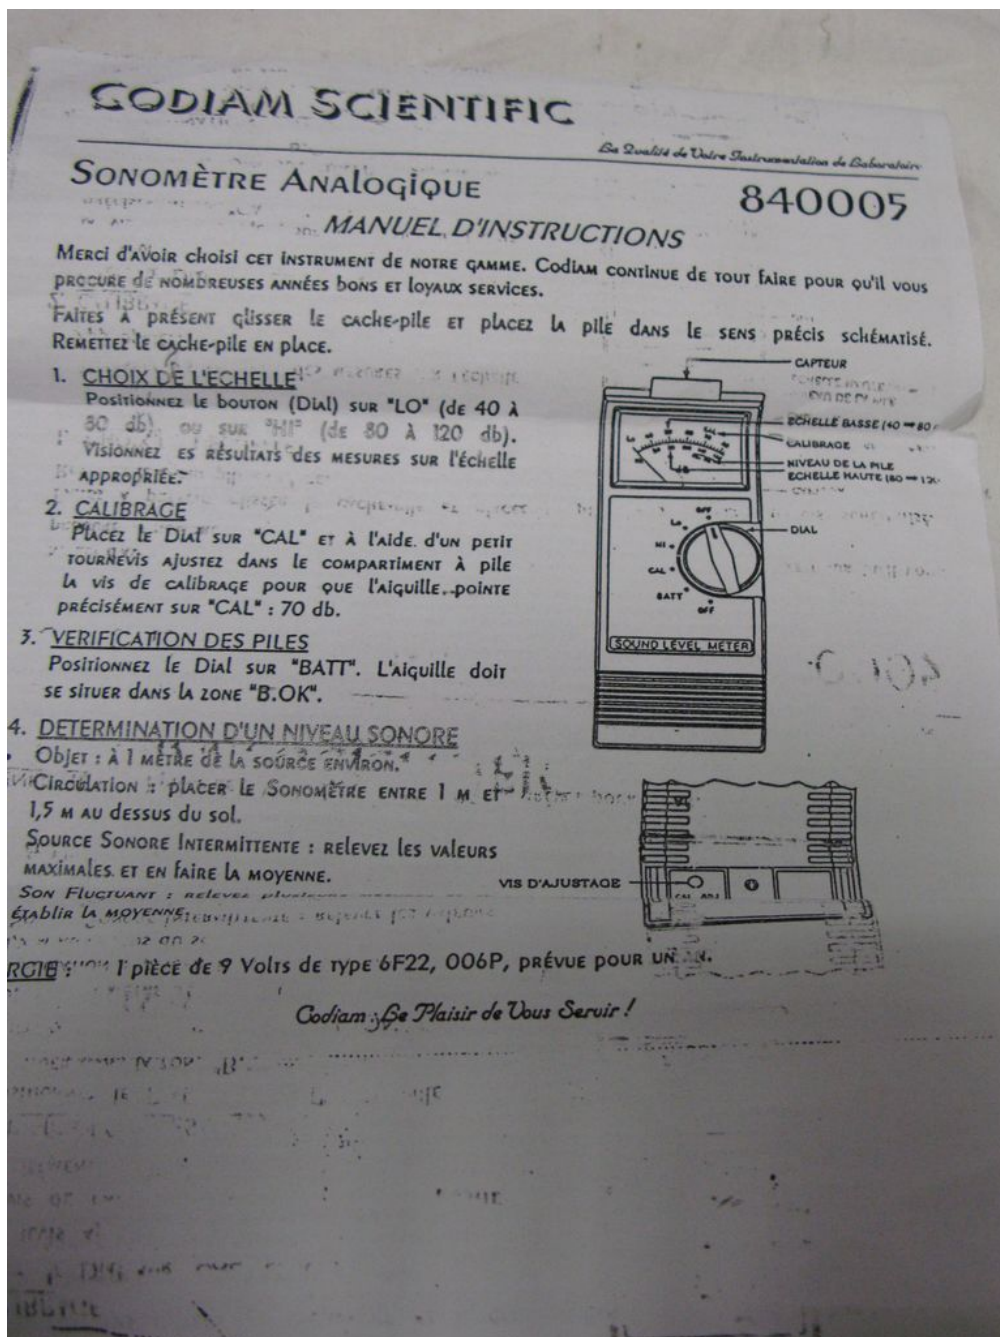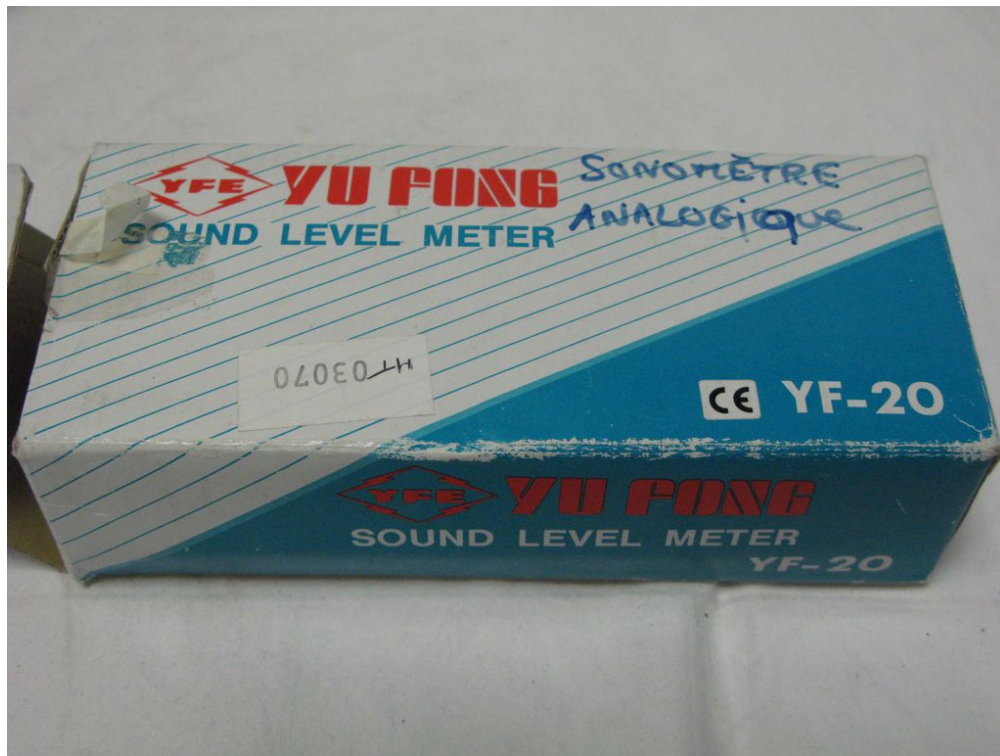

**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Sonomètre analogique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14317>, consulté le 2026-07-27