

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PH-MÈTRE METTLER TOLEDO SEVEN EASY

FICHE N° 11040

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Mettler Toledo

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description


L'appareil est composé d'un boîtier en plastique. Il est relié à la sonde de pH. Il se compose d'un écran LCD affichant la valeur de la mesure et plusieurs touches pour déclencher la mesure, calibrer et choisir l'unité (pH ou mV).

Utilisation

Ce pH-mètre est utilisé par le personnel encadrant de l'IUT Génie Biologique pour la préparation des travaux pratiques ou les activités de recherche.





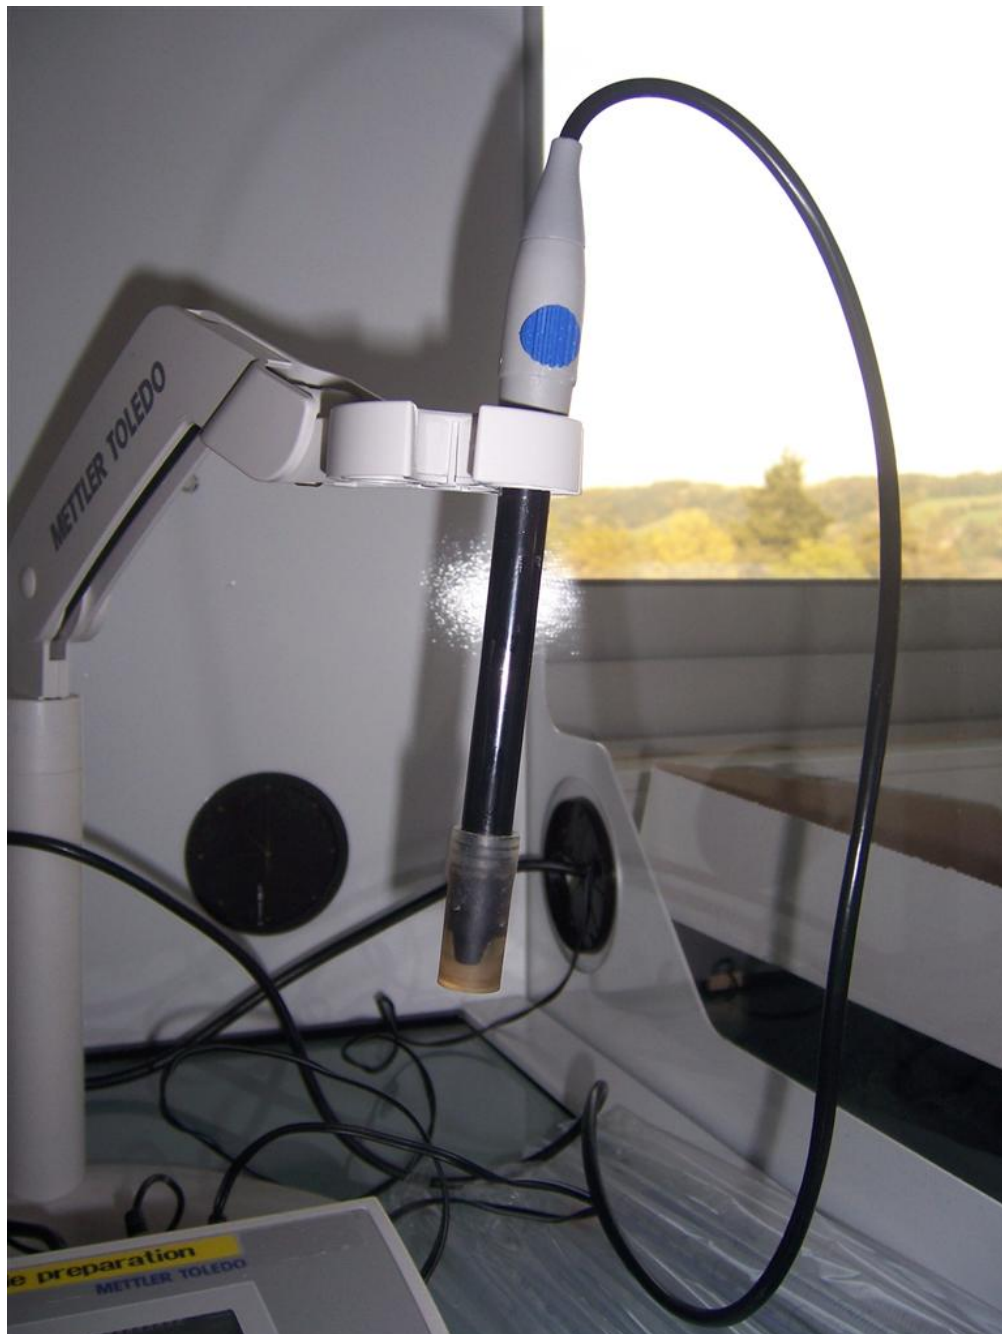

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, pH-mètre Mettler Toledo Seven Easy (Mettler Toledo), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14445>, consulté le 2026-07-27