

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PH-MÈTRE INOLAB WTW

FICHE N° 11048

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : WTW

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : InoLab

Matériaux :


Description

Il s'agit d'un boîtier en plastique muni d'un écran LCD et d'un clavier. A l'arrière se trouve une prise pour brancher la sonde de détermination du pH.

Utilisation

Cet appareil permet de mesurer le pH. Il est utilisé par les étudiants de l'IUT d'Aurillac lors des travaux pratiques de chimie.



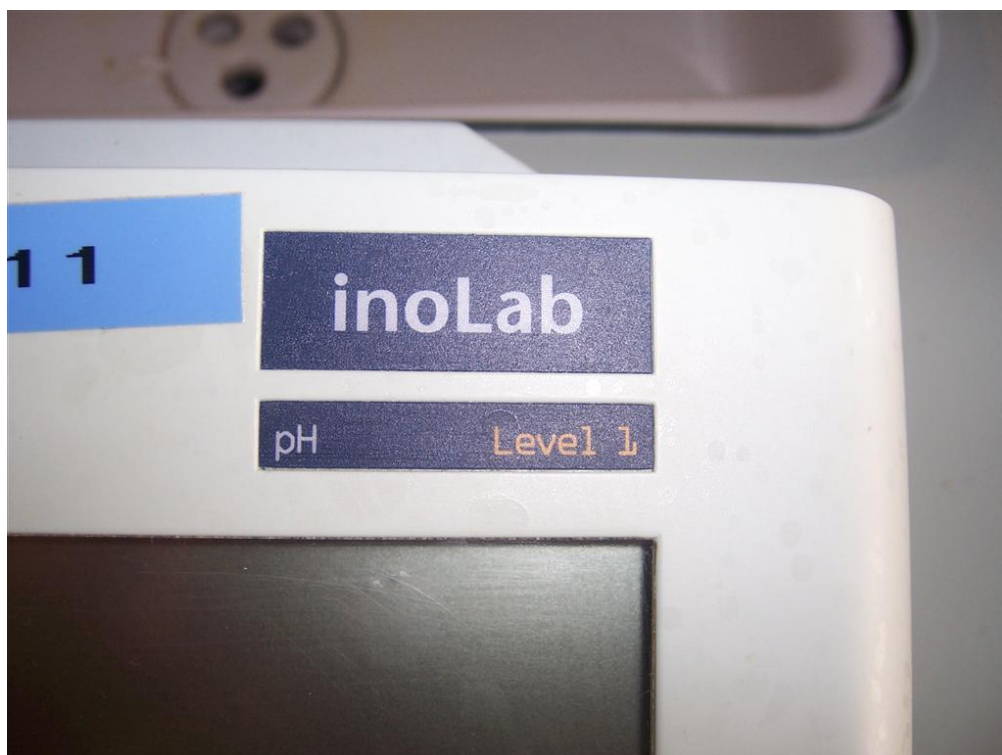



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, pH-mètre InoLab WTW (WTW),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14453>, consulté le 2026-07-27