

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

STÉRILISATEUR GLASSBEAD HEATER

FICHE N° 11253

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Hager Werken

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :



Description

L'appareil possède un corps en métal. Au niveau supérieur, on soulève un couvercle et en dessous se trouve une coupelle remplie de billes de verre, c'est la chambre de stérilisation qui peut atteindre une température de 230°C. Un interrupteur permet la mise en fonction du système et des voyants lumineux indiquent si la température souhaitée est atteinte.

Utilisation

Cet appareil permet une stérilisation rapide des instruments juste avant leur utilisation. Il est normalement utilisé par les dentistes. A l'IUT d'Aurillac il est utilisé pour stériliser les instruments de culture in vitro (scalpels, pinces, ciseaux).



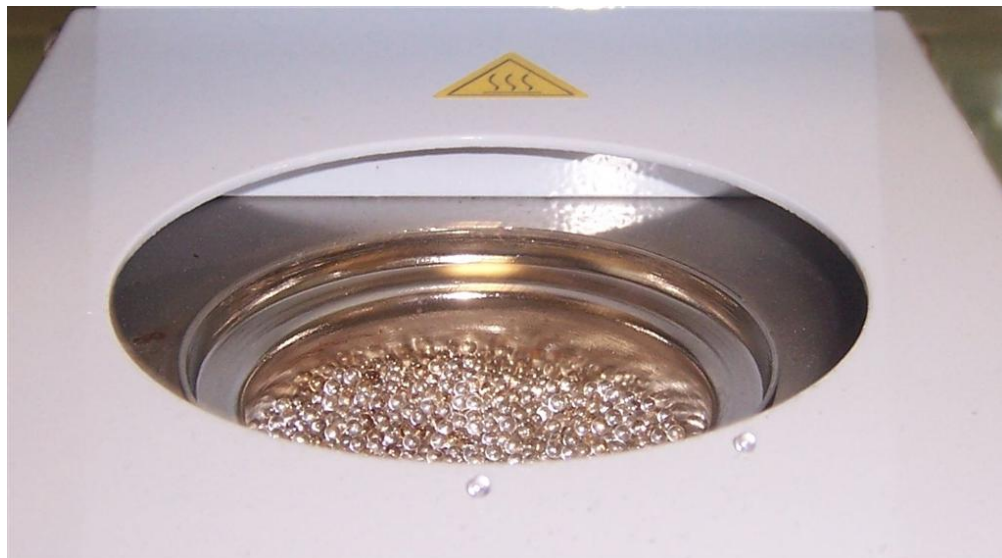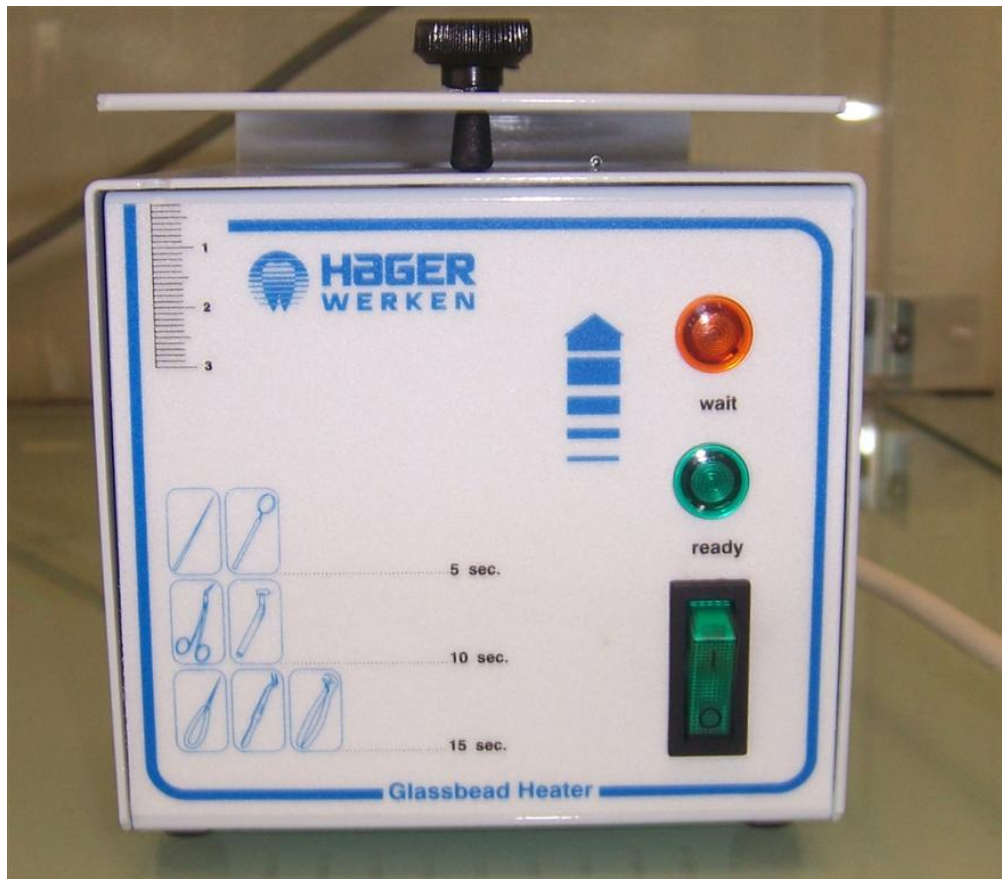





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Stérilisateur Glassbead Heater (Hager Werken), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14658>, consulté le 2026-07-27