

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SPECTROFLUOROMÈTRE AMINCO SPF-500

FICHE N° 11312

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : SPF-500

Matériaux :

Description

La partie haute de l'appareil est dédiée aux commandes. Il y a un compteur affichant les minutes et un autre la longueur d'onde en nm. Un écran digital indique la fluorescence relative et le pourcentage de transmittance.

En dessous, on observe des courroies, un moteur, et la chambre de mesure.

Cet appareil fonctionne avec une lampe au xénon qui semble manquante.


Utilisation

Cet appareil était utilisé pour obtenir le spectre de fluorescence et le pourcentage de transmittance (= fraction d'intensité lumineuse traversant l'échantillon) d'une solution.







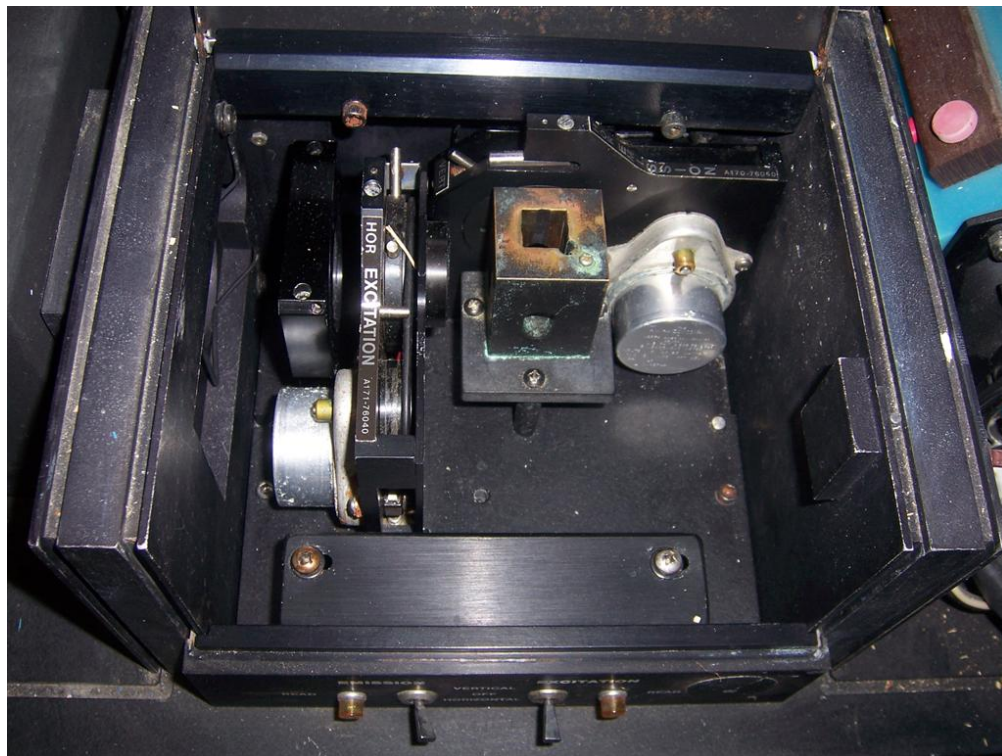

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spectrofluoromètre Aminco SPF-500 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14717>, consulté le 2026-07-27