

COUTEAU D'ULTRAMICROTOME

FICHE N° 1793

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : SCIAM

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Angers - UFR Sciences médicales

Ville : Angers

Modèle :


Matériaux :


Description

Le couteau d'ultramicrotome est débité dans des baguettes de verre sur l'appareil à fabriquer les couteaux (Knifemaker). Il a une forme triangulaire avec un angle de coupe à 45°. Il est utilisé sur l'ultramicrotome Ultracut S de REICHERT.

Utilisation

La couteau est fabriqué en interne dans le Service Commun d'imageries et d'analyses microscopiques (SCIAM). Cet accessoire permet de réaliser des coupes ultrafines biologiques qui seront ensuite observées par microscope électronique.

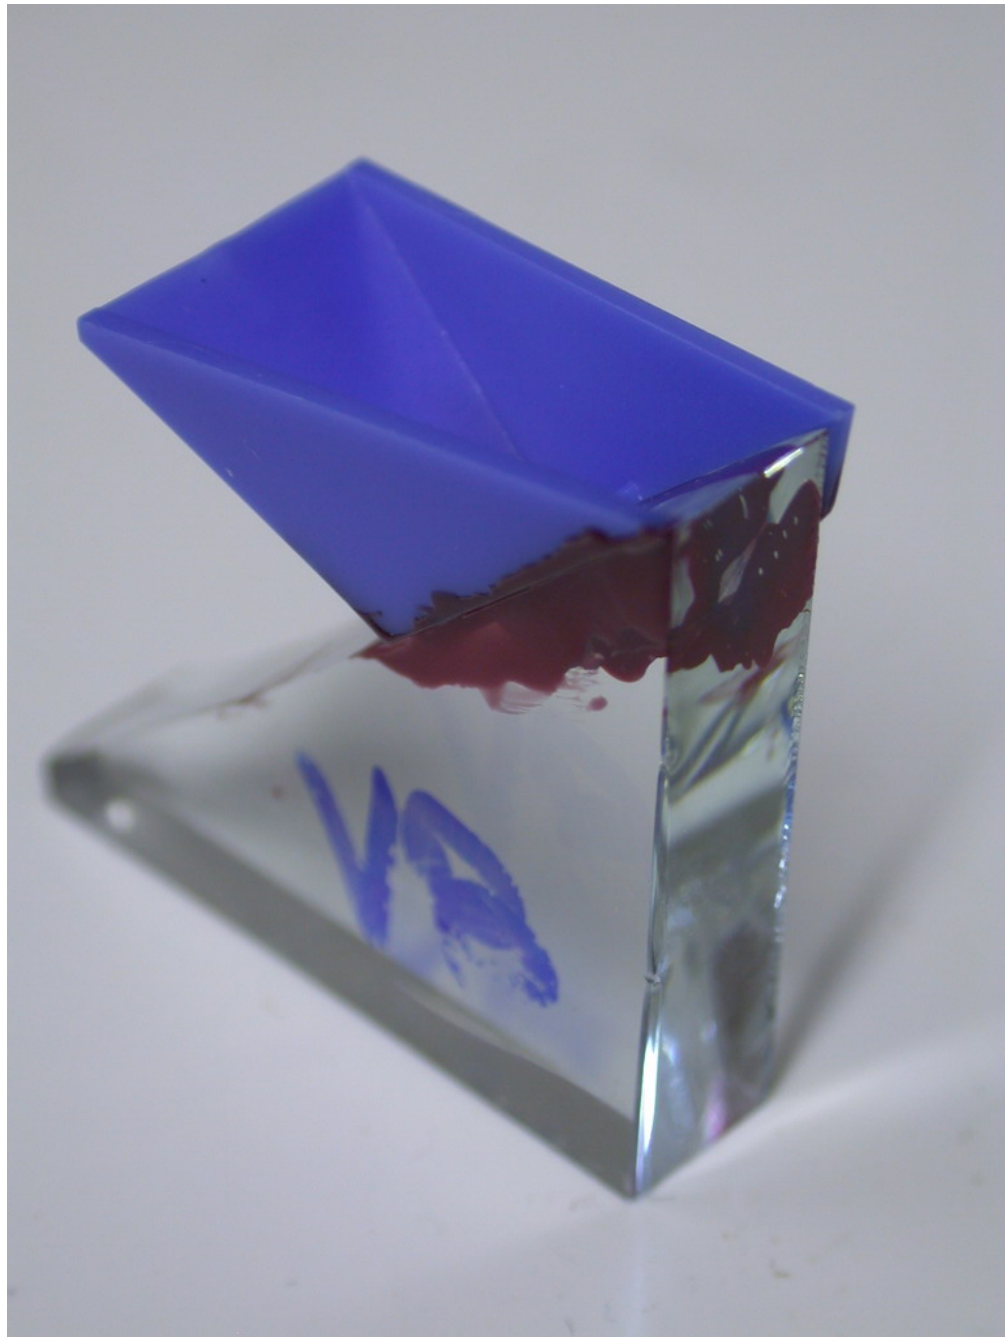

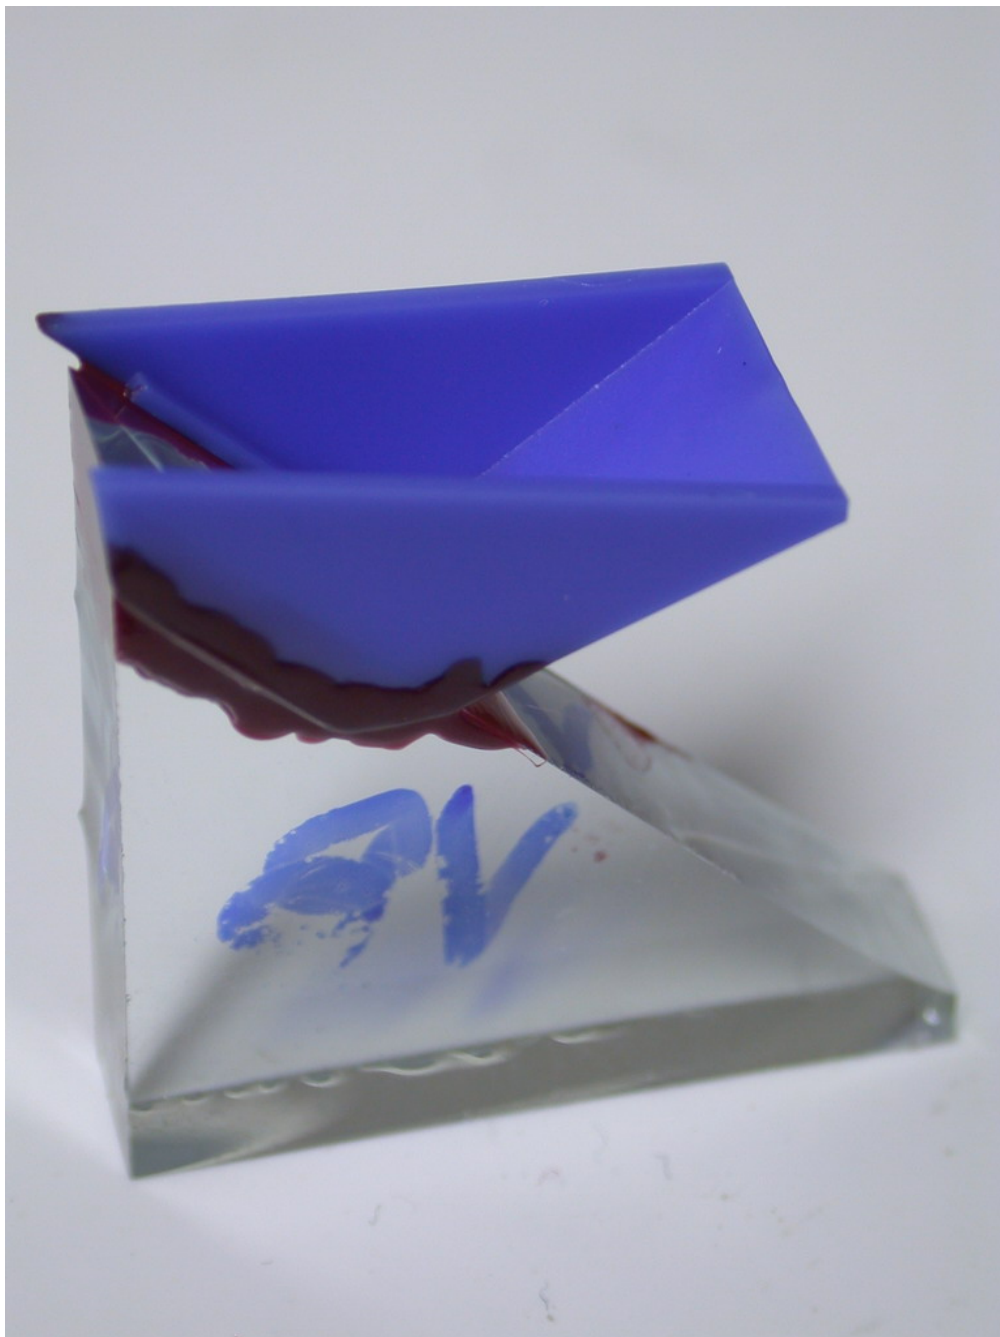

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Couteau d'ultramicrotome (SCIAM), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1718>, consulté le 2026-07-22