

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MICROSCOPE INVERSÉ

FICHE N° 1906

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Olympus

Domaines : Santé

Sous-domaines : Electrophysiologie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes - UFR de médecine

Ville : Nantes

Modèle :


Matériaux :


Description

Le microscope inversé OLYMPUS fait partie du dispositif d'enregistrement patch-clamp. Ses composants sont les mêmes que ceux d'un microscope ordinaire, à la différence que ceux-ci sont disposés de haut en bas à partir de la source lumineuse, c'est-à-dire à l'inverse de l'habitude, d'où son nom de microscope inversé. Les objectifs se situent sous la platine d'observation. Il possède deux oculaires, une colonne d'éclairage, une très large platine, un bouton de mise au point.

Utilisation

Cet instrument était utilisé par le laboratoire de Physiopathologie et pharmacologie cellulaire et moléculaire de l'Université de Nantes.

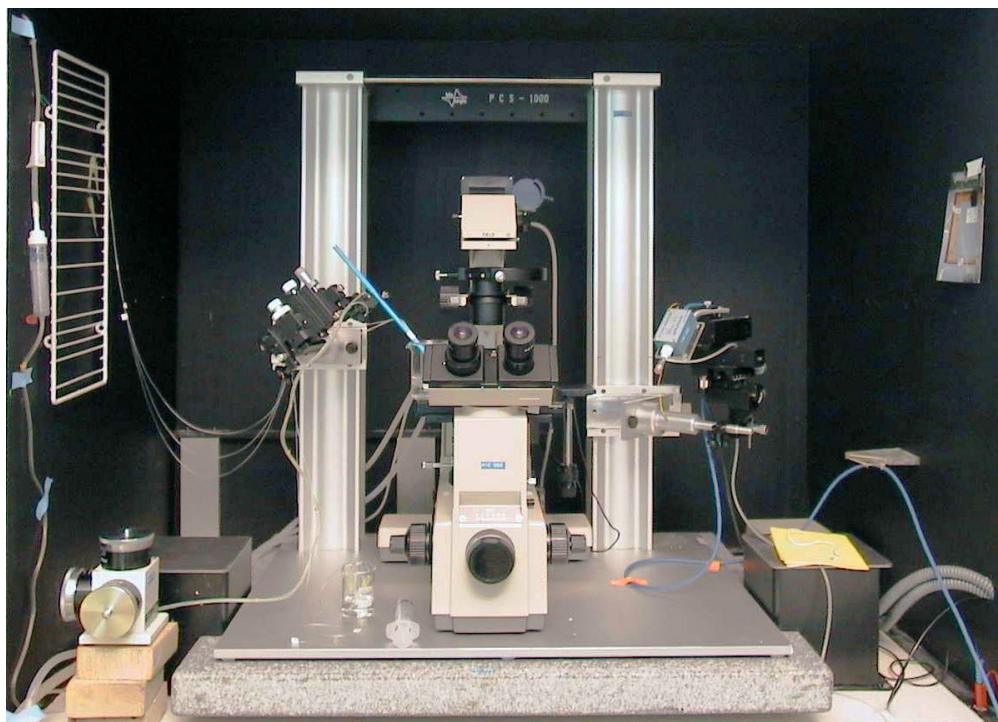

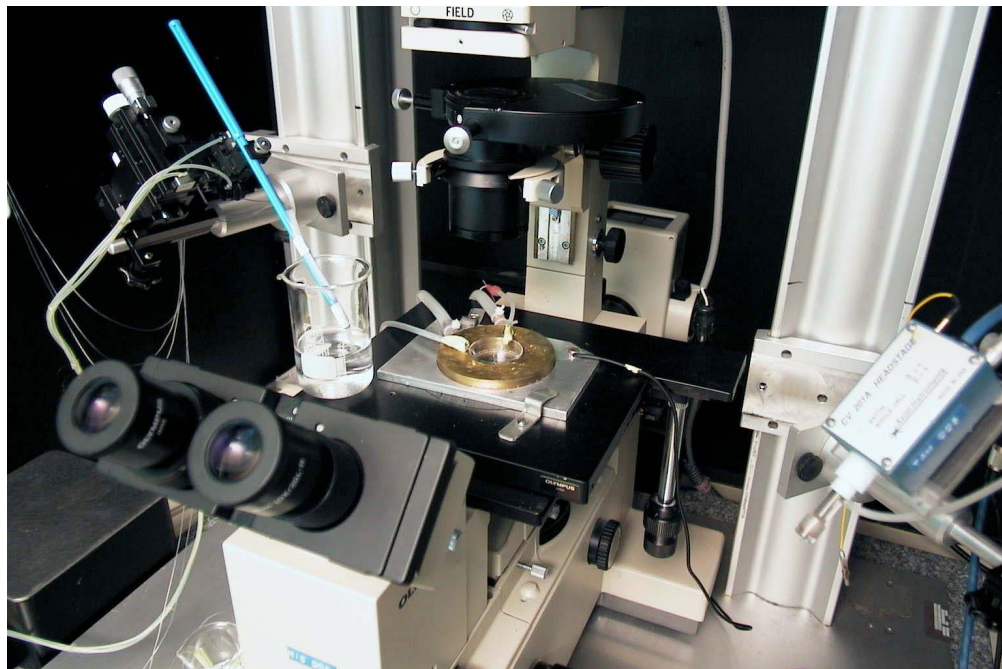

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Microscope inversé (Olympus), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1827>, consulté le 2026-10-18