

STIMULATEUR CARDIAQUE

FICHE N° 1918

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-2000

Fabricant : Digitimer Ltd

Domaines : Santé

Sous-domaines : Electrophysiologie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes - UFR de médecine

Ville : Nantes

Modèle : DS2A - MK.II


Matériaux :

Description

Le stimulateur fait partie du dispositif d'enregistrement de potentiel d'action de cellules ventriculaires cardiaques.

Il permet de stimuler la cellule selon des programmes particuliers et de recueillir, en conséquence, les mesures des mouvements ioniques qui se produisent de part et d'autre de la membrane de la cellule.

Utilisation

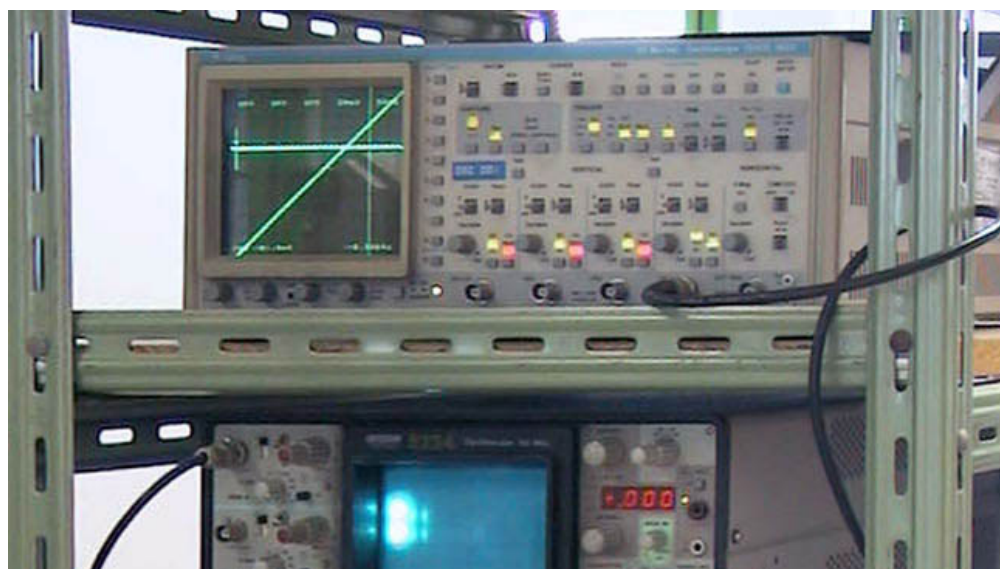

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Stimulateur cardiaque (Digitimer Ltd), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1839>, consulté le 2025-02-14