

RÉFRACTOMÈTE UV

FICHE N° 3997

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : RI-150

Matériaux :


Description


Ce réfractomètre UV SpectraSYSTEM est un parallélépipède d'acier blanc cassé à l'avant en forme de trapèze. A l'avant, en haut à gauche, l'écran de contrôle et à droite, les panneaux de contrôle. Sur le côté droit, 2 orifices d'insertion.

Utilisation

Cet exemplaire était utilisé au sein du laboratoire de Chimie Organique Fine (COBRA) de l'université de Rouen



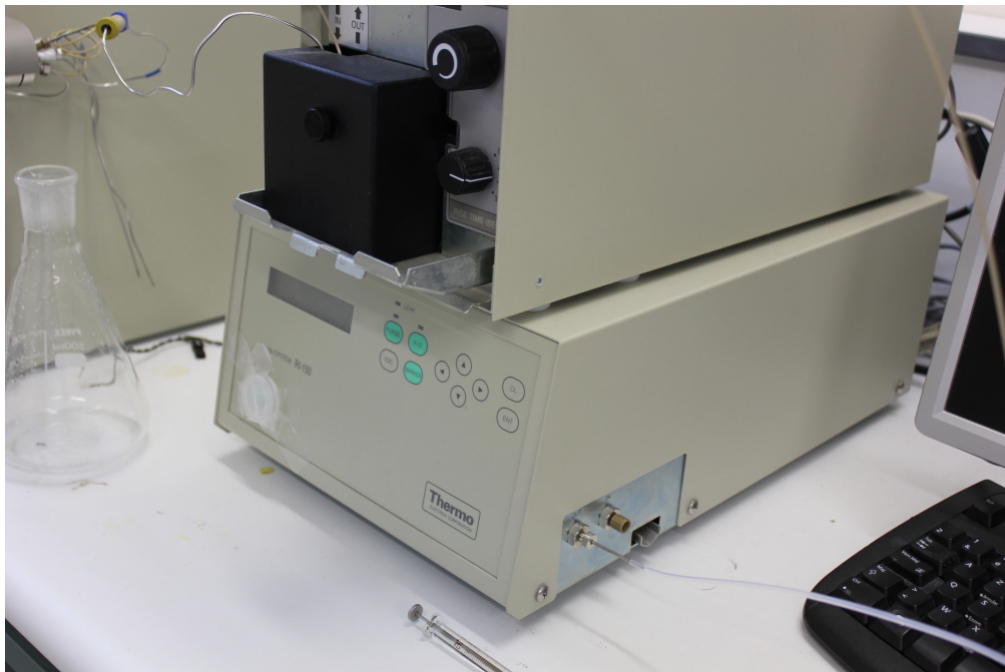

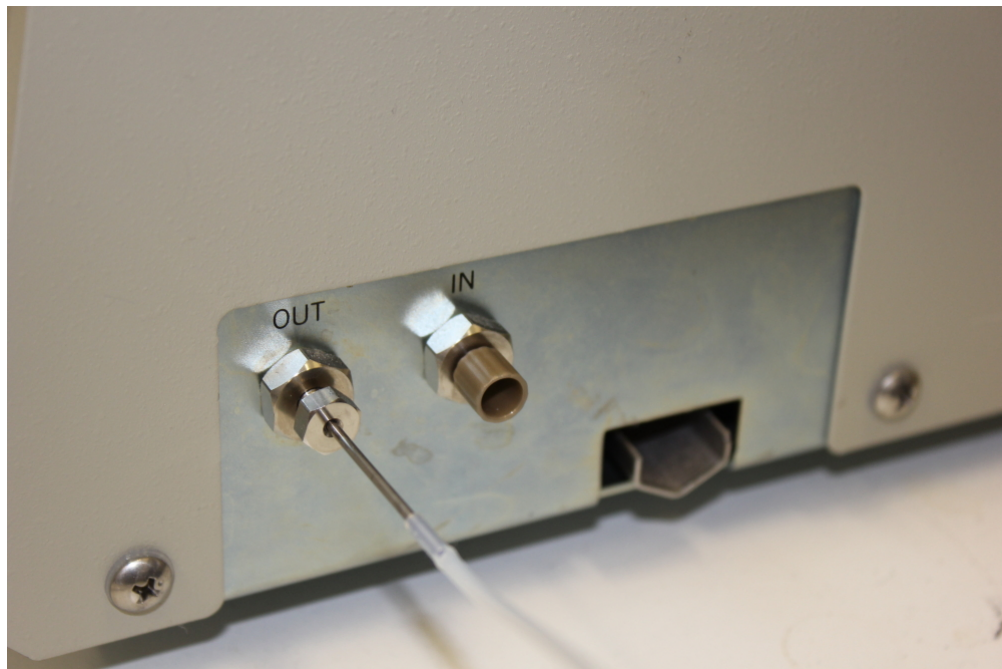

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Réfractomètre UV (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20387>, consulté le 2026-07-30