

PASSEUR D'ÉCHANTILLONS

FICHE N° 4038

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : CTC Analytics

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : MXY 02-01B

Matériaux : Plastique, Chrome, Acier, Plastique Plexiglas, marque déposée, Cuivre

Description

Ce passeur d'échantillons CTC Analytics est un bras articulé vissé au-dessus du chromatographe à gaz (répertorié sous SMS-004). C'est une barre horizontale sur laquelle est montée: à droite une sorte de "nacelle" qui accueille les petits flacons d'échantillons, au milieu un bloc perpendiculaire avec à l'intérieur une seringue de solution, à gauche un petit bras accueillant des flacons d'échantillon plus gros, puis un bloc rose en acier dans lequel on peut placer des flacons de taille moyenne. Tout à gauche, la télécommande avec son écran, ses boutons et sa molette de réglage rotative.


Utilisation

Cet instrument est utilisé dans les laboratoires de recherche du SMS et du COBRA. Cet instrument permet la programmation, l'injection et la récupération des échantillons à analyser par le chromatographe à gaz, répertorié sous SMS-005.








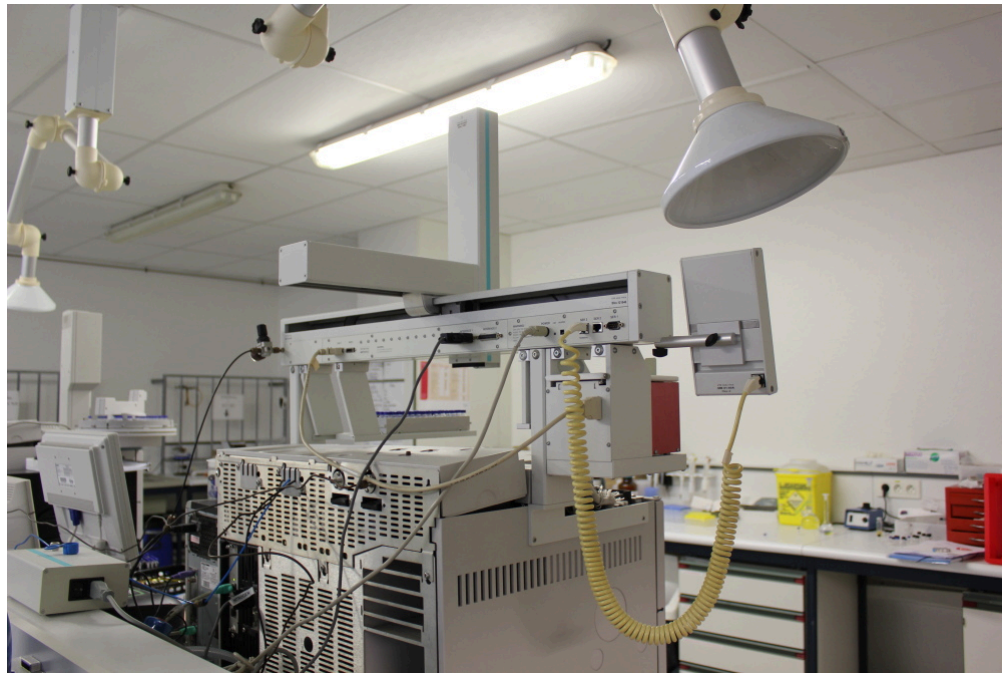



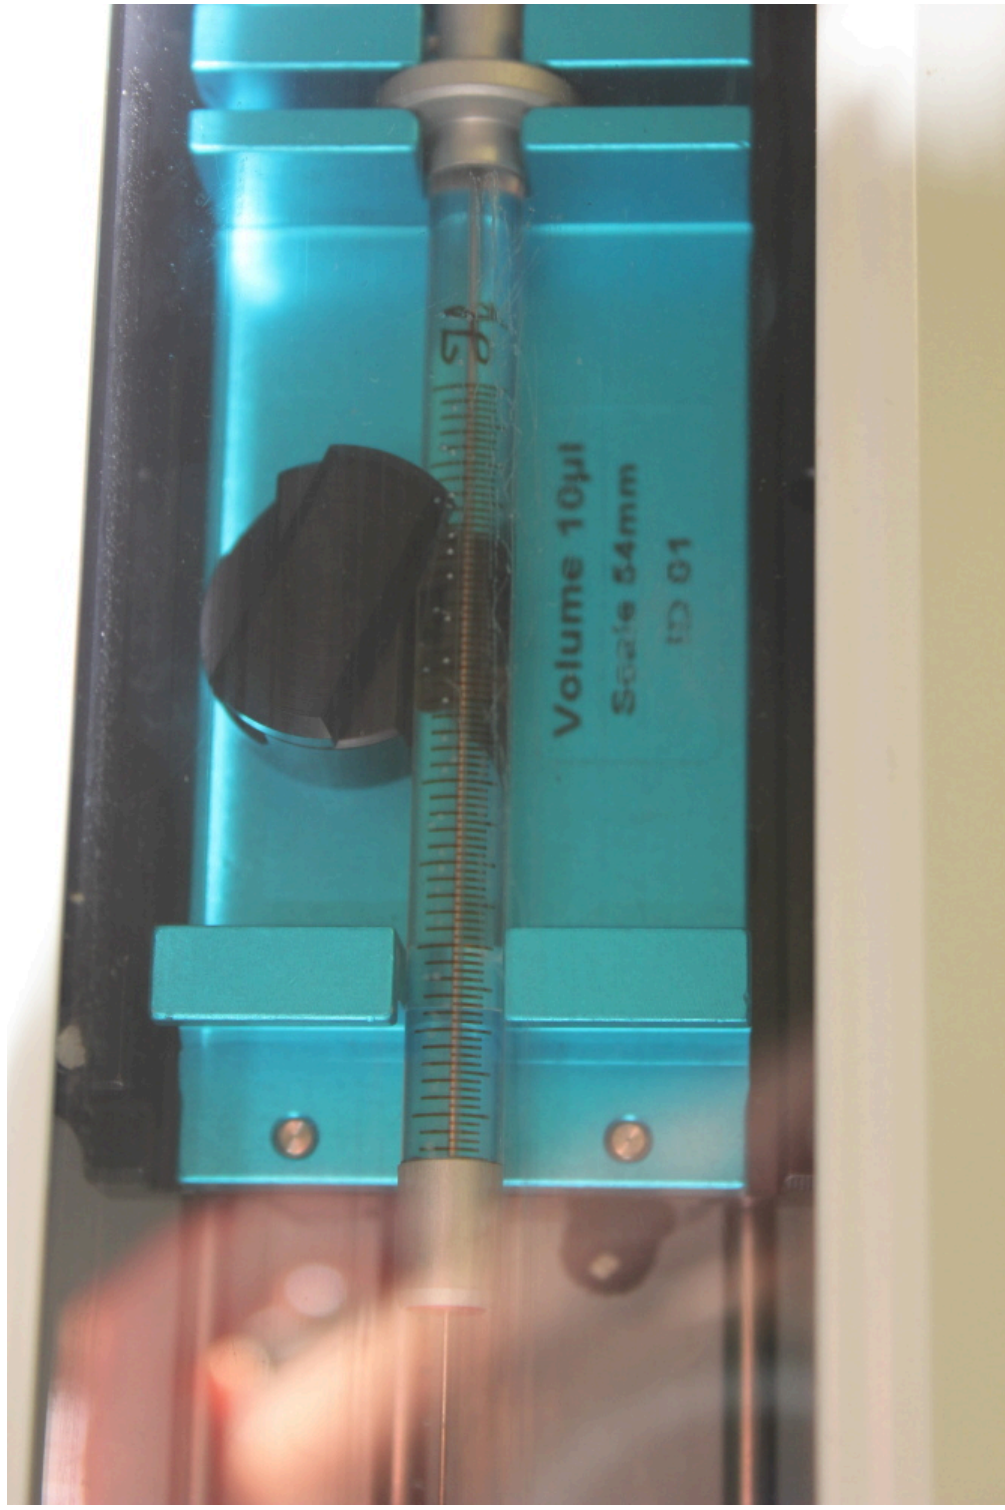



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Passeur d'échantillons (CTC Analytics), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20428>, consulté le 2026-07-30