

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

STIMULATEUR NEUROPHYSIOLOGIE

FICHE N° 457

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : G.Boulitte ; G.Boulitte ; G.Boulitte

Domaines : Santé

Sous-domaines : Neurosciences

Organisme : Laboratoire de Neurosciences Cognitives

Ville : Marseille

Modèle :

Matériaux :


Description

Le stimulateur neurophysiologie de G.Boulitte sert à stimuler des nefs. Le voltmètre permet de contrôler la tension continue du système compris entre 0 et 20 volts et autour des secteurs. Il sert à baisser la tension. Il doit exister à l'origine une alimentation continue par batterie. Cet instrument se présente sous forme de coffret en bois comprenant un système apériodique à cadre mobile et des boutons pour sélection différents circuits de résistances, 20 volts continue.

Utilisation

L'objet se trouve dans la salle des voûtes à la faculté des Sciences à St Charles, il est utilisé pour l'enseignement.



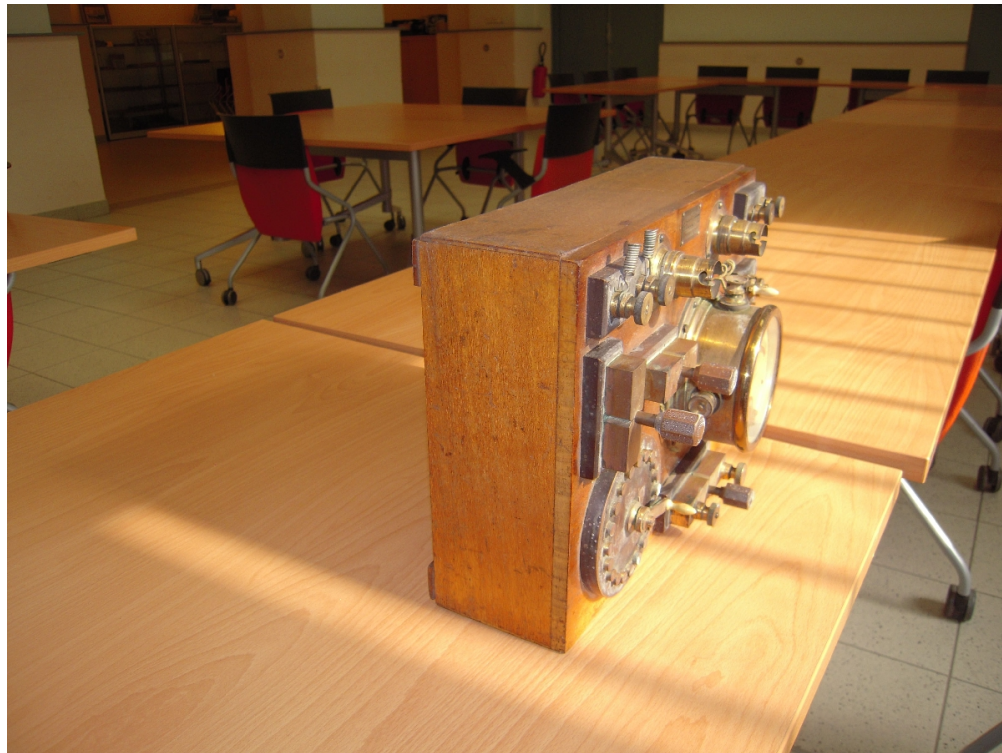



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Stimulateur neurophysiologie (G.Boulitte ; G.Boulitte ; G.Boulitte), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24602>, consulté le 2026-07-28