

APPAREIL MÉDICO-CHIRURGICAL

FICHE N° 9407

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Ets BRODARD

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

L'appareil médico-chirurgical parallélépipédique est métallique et assez lourd. Une poignée métallique permet le transport, une sangle à l'arrière doit permettre de l'accrocher au mur.

A l'avant se trouvent un interrupteur, un voyant lumineux rouge et deux molettes. Une notée "Lumière" l'autre "Cautere". La molette pour la lumière comporte une graduation de 0 à 100. La plaque a été découpée pour qu'on ne dépasse pas le 50.


La molette Cautere est graduée de 0 à 100. Une cale, à la base, empêche de dépasser le 60.


Quatre bornes permettent de brancher deux accessoires.


L'accessoire est rectangulaire avec au sommet deux éléments métalliques de forme demi-sphérique et munis de vis. Sur le manche un rail permet de faire coulisser un plot.

Utilisation

Cet appareil pourrait être un électrocautère, appareil servant à cautériser les tissus à l'aide d'un fil chauffé au rouge par le passage d'un courant électrique.

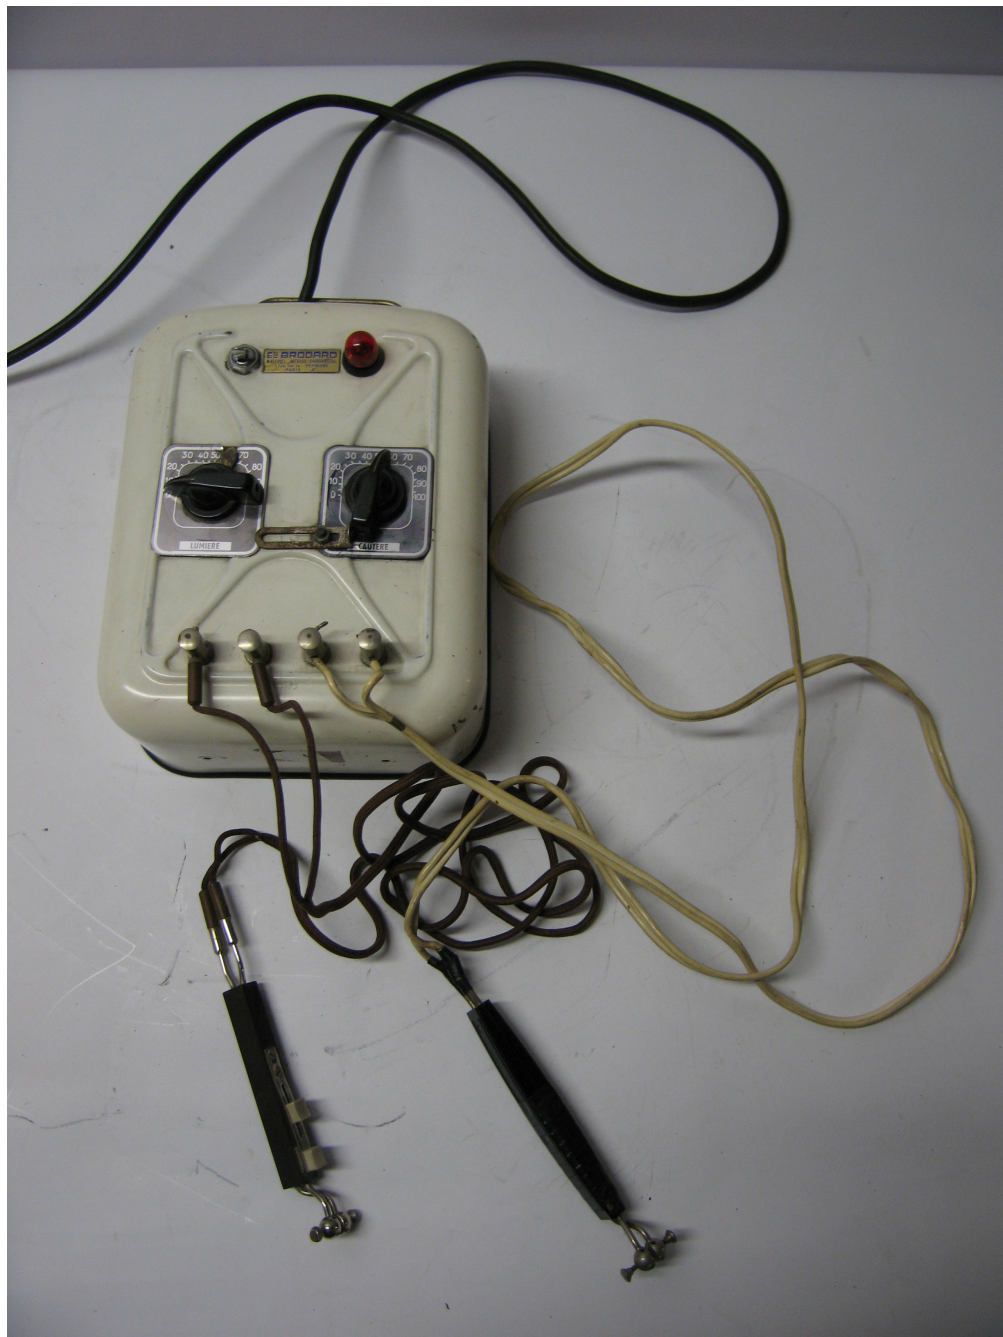

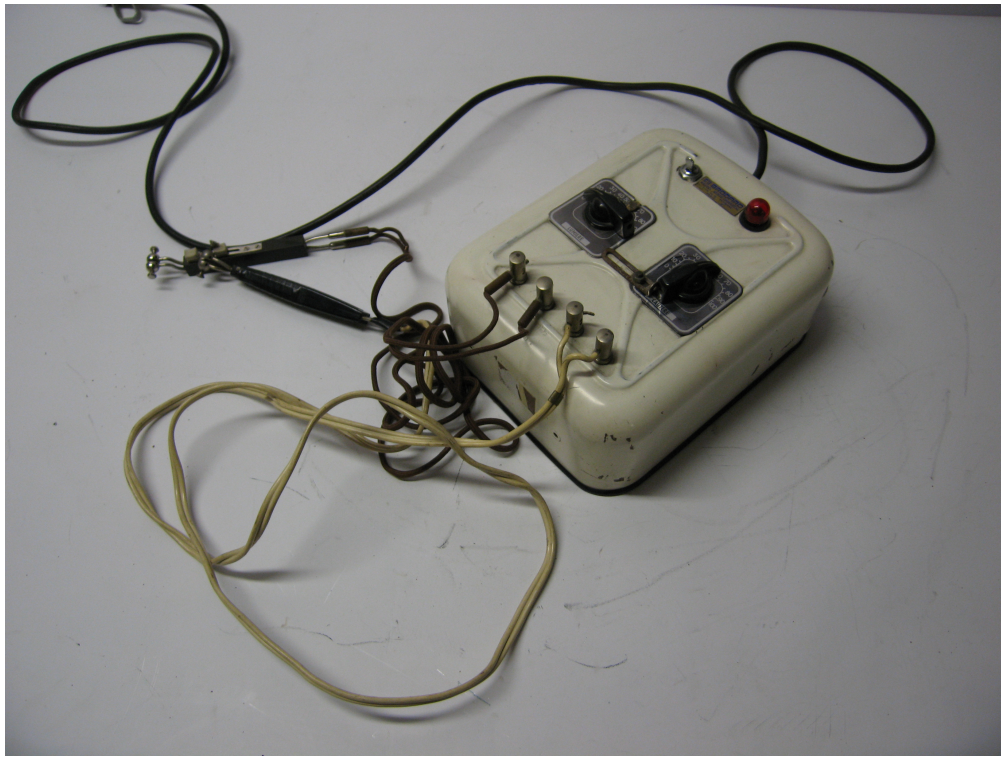

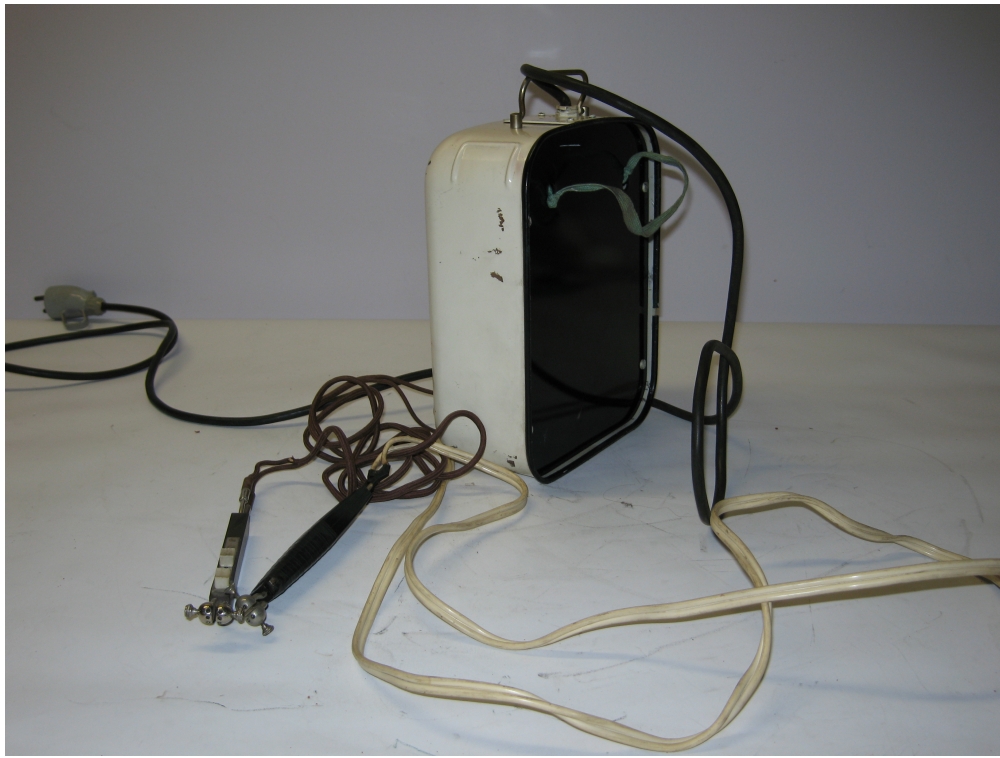

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil médico-chirurgical (Ets BROADARD), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33991>, consulté le 2026-07-22