

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SONDE D'INTUBATION ENDO-TRACHÉALE

FICHE N° 2736

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : A. Charles King

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Association Histoire des hôpitaux et patrimoine de la santé à Nantes

Ville : Nantes

Modèle : James

Matériaux : Caoutchouc


Description

La sonde d'intubation endo-trachéale pour enfant Ch. KING est dite "de James". Il s'agit d'un tube en caoutchouc orange, coudé à angle droit pour une introduction trachéale. Sonde utilisée par trachéotomie, elle est insérée dans la trachée du patient après une incision chirurgicale au niveau de la trachée haute, sous le larynx. La courte longueur est nécessaire pour éviter d'atteindre les poumons. Elle est munie d'un embout en métal et d'un petit ballonnet, permettant de la gonfler et de l'immobiliser lorsqu'elle est en place chez le patient.

Utilisation

Cette sonde était utilisée, après stérilisation, en anesthésie-réanimation au CHU de Nantes.



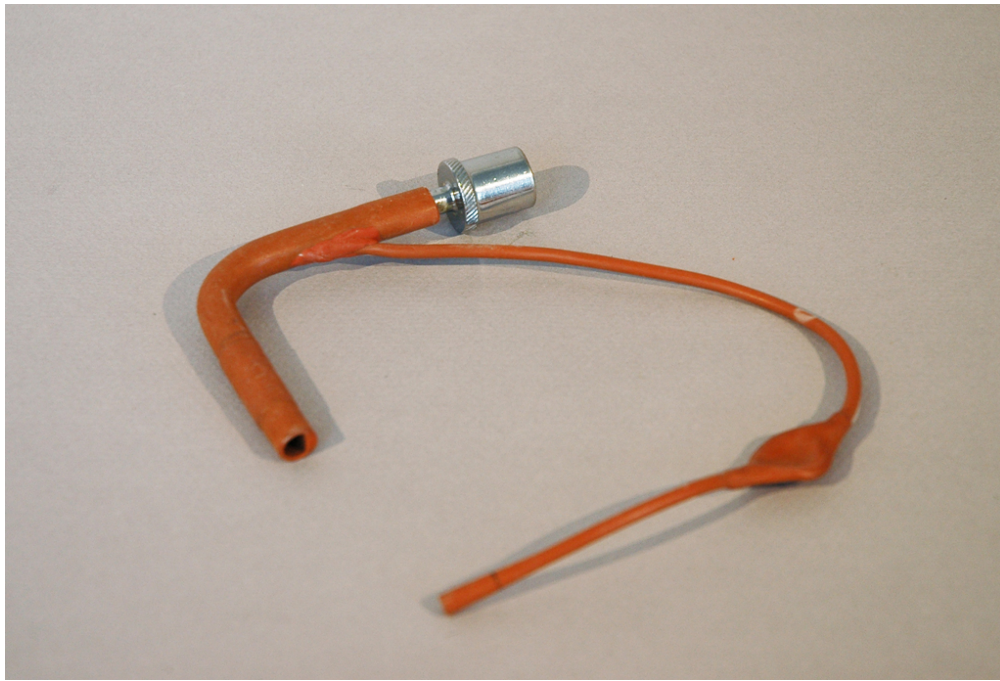

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Sonde d'intubation endo-trachéale (A. Charles King), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3416>, consulté le 2026-07-22