

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MICRO-AMPÈREMÈTRE

FICHE N° 29484

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : CAMPDEN INSTRUMENTS LTD

Domaines : Médecine hospitalière

Sous-domaines : Recherche médicale

Organisme : Bibliothèque centrale du Service de santé des Armées

Ville : Paris

Modèle : Shock Source 521 C

Matériaux : Plastique, Aluminium, Acier inoxydable, Papier, Cuivre, Fer

Description


Ce microampèremètre se présente sous la forme d'un boîtier métallique rectangulaire. La face avant est légèrement plus haute que les autres. Elle présente un cadran rectangulaire, gradué de 0 à 50 en μA ; en dessous, deux bornes d'entrée et de sortie du courant électrique ; à droite, plusieurs éléments permettant les réglages : un levier de mise en marche, une lampe rouge, un bouton de calibrage, deux molettes et deux rangées de cinq bornes représentant un % du courant fixé. Sur ces bornes, deux fils électriques peuvent y être fixés aléatoirement. La moitié des deux fils est colorée, soit en bleu, soit en rouge. Ils sont tous deux reliés à un même boîtier doté d'un interrupteur. Un câble de branchement avec sa prise part de la face arrière de l'appareil, en partie basse. Plus au dessus, deux étiquettes indiquent la date de test de la machine et son numéro de série. A l'arrière de la face avant, cet appareil possède deux crochets métalliques permettant de les intégrer dans une étagère métallique de type "rack" à côté d'autres appareillages.


Ce micro-ampèremètre permettait de mesurer le courant électrique à une très faible intensité.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé au sein du laboratoire d'Eutonologie d'Henri Laborit à l'hôpital Boucicaut à Paris.



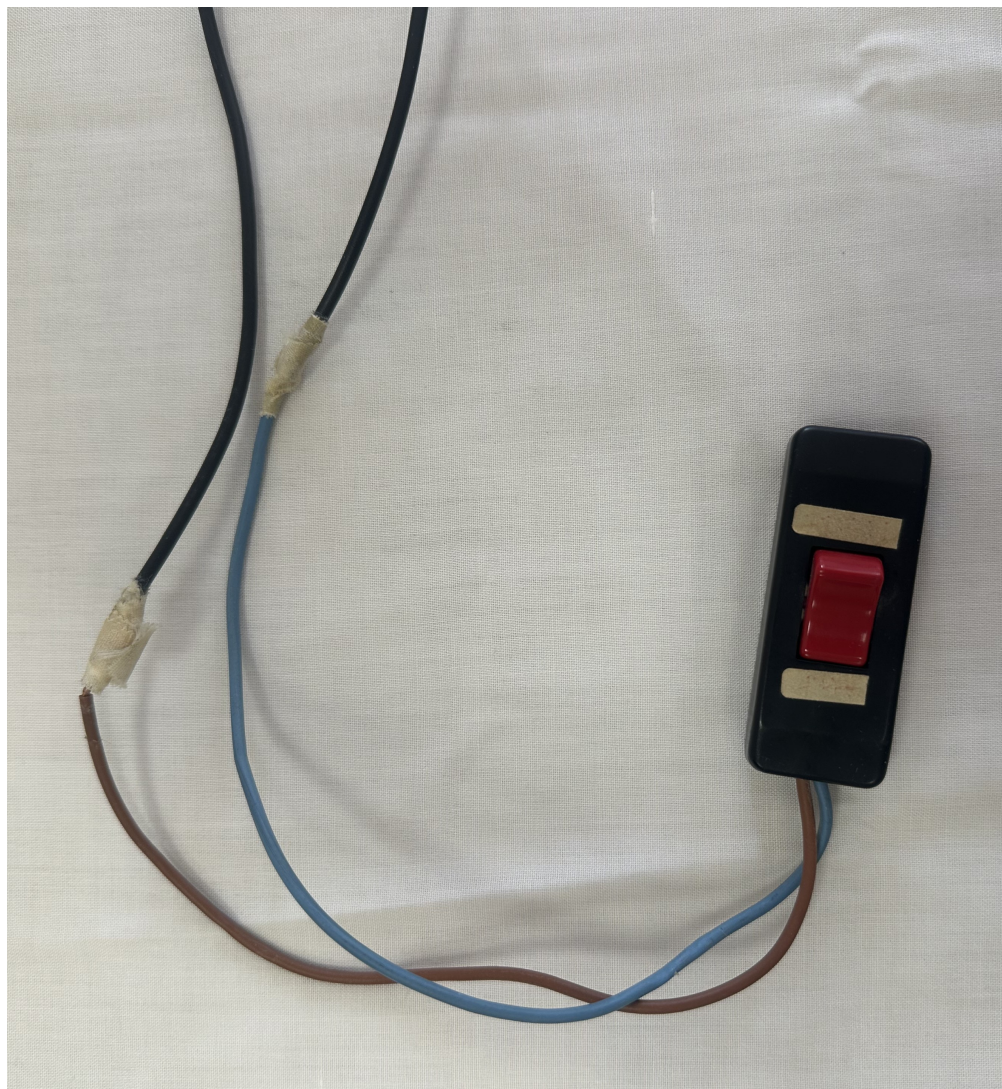

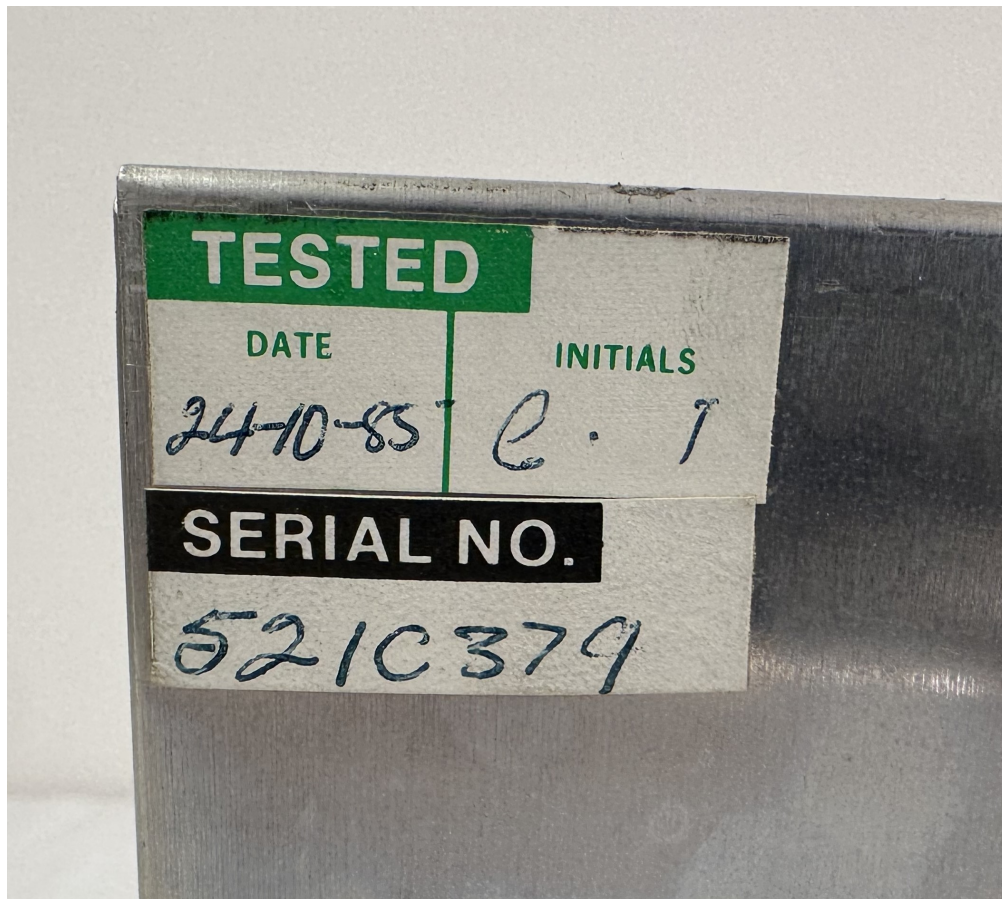

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Micro-ampèremètre (CAMPDEN INSTRUMENTS LDT), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=35832>, consulté le 2026-09-01