

SUPPORT À PINCE DOUBLE POUR ÉLECTRODES

FICHE N° 31232

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Prolabo

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie analytique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle :


Matériaux : Acier, Fonte, Plastique Plexiglas, marque déposée

Description

Le support Labomeca à pince double pour électrodes comporte deux pièces. Un statif muni d'une courte tige en acier inox (diamètre 8 mm) est fixé sur pied lourd, ayant une forme qui lui confère une très grande stabilité. À l'extrémité d'une tige en acier est fixée une pince en méthacrylate de méthyle, de forme plus ou moins rectangulaire, comportant deux échancrures sur les côtés et deux lames en acier qui permettent de bloquer des électrodes à l'aide de vis. La liaison entre le statif et la tige de la pince se fait à l'aide d'une noix Labomeca 8/8. Ce dispositif est utilisé lors de dosages pH-métriques ou potentiométriques.

Utilisation

Le support Labomeca à pince double pour électrodes a été utilisé pour des travaux de recherche en chimie analytique dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.

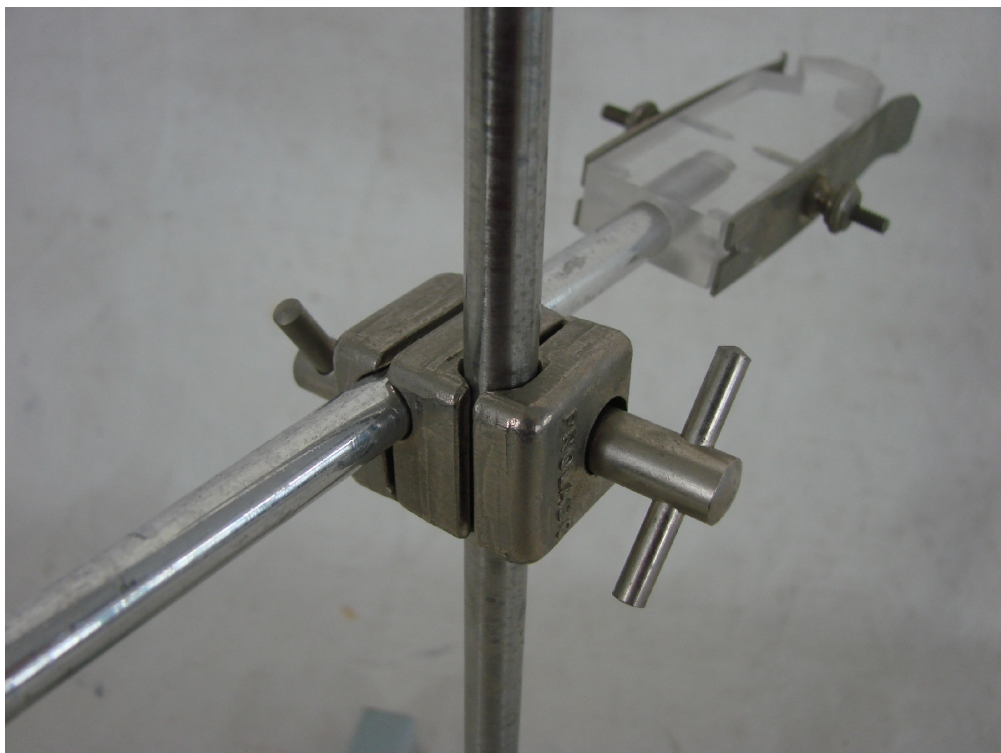

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Support à pince double pour électrodes (Prolabo), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4876>, consulté le 2026-07-24