

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## PLATINE CHAUFFANTE POUR HISTOLOGIE

FICHE N° 31282

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : JOUAN

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie végétale, Biologie animale, Biochimie

Organisme : Université Catholique de l'Ouest

Ville : Angers

Modèle : Pla.hist

Matériaux : Acier, Aluminium


### Description

La platine chauffante pour histologie Jouan est constituée d'un long boîtier métallique avec dessus en aluminium anodisé. A l'intérieur une résistance chauffante, commandée par un potentiomètre extérieur réglable de 0 à 10, chauffe la partie droite du dessus. La température maximale atteinte est de 65°C. A l'autre extrémité la température est de l'ordre de 40°C. Un interrupteur arrêt/marche avec voyant lumineux, en façade, et un fusible à l'arrière, complètent l'appareil. La platine chauffante pour lames microscopiques, est utilisée en cytologie et histologie. La surface sombre en aluminium anodisé, permet un meilleur contraste.

### Utilisation

La platine chauffante pour histologie a été utilisée pour des travaux pratiques dans les laboratoires de biologie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.



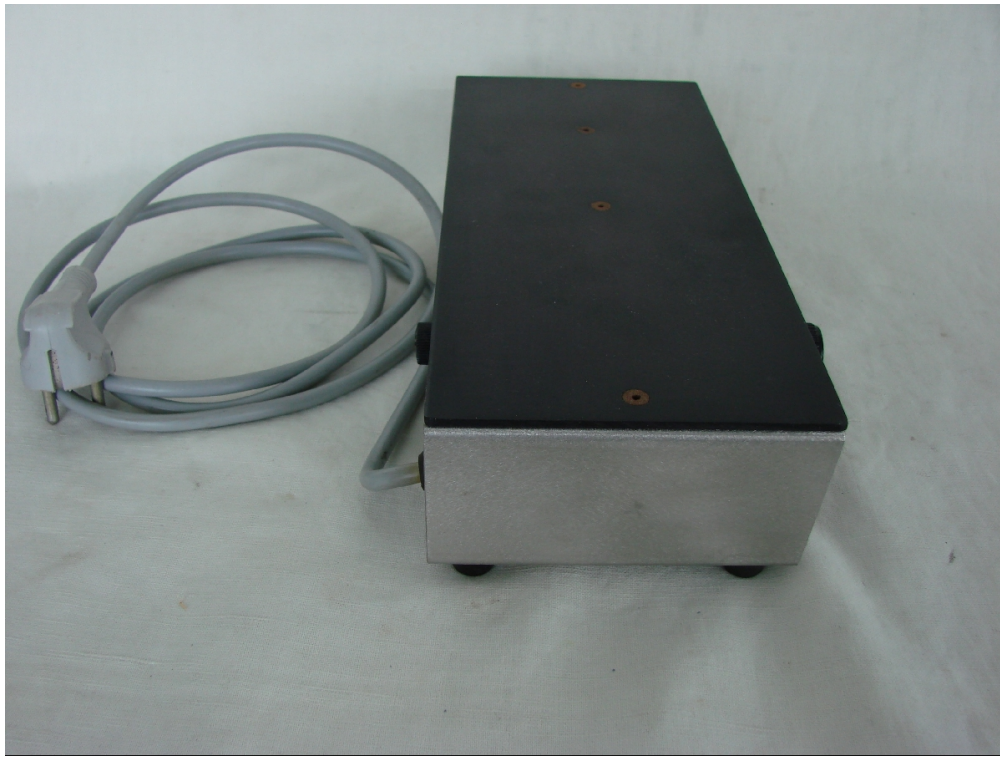



Made in France by JOUAN  
N° SERIE : 39701466 TYPE : PLA.HIST  
Volts : 220-240 Hz : 50-60 VA : 60 CE

**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Platine chauffante pour histologie (JOUAN), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4926>, consulté le 2026-07-24