

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BAIN-MARIE DE SÉROLOGIE

FICHE N° 31283

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : LABOVER

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie végétale, Biologie animale, Biochimie

Organisme : Université Catholique de l'Ouest

Ville : Angers

Modèle : BM 82


Matériaux : Acier, Plastique Plexiglas, marque déposée


Description

Le bain-marie électrique de sérologie Labover est constitué d'une cuve transparente en plexiglas avec couvercle amovible. A l'intérieur un support percé d'alvéoles, permet de chauffer jusqu'à 40 tubes à essais. Les résistances chauffantes placées au fond de la cuve assurent un chauffage entre 25 et 60°C grâce à un thermostat ayant une position préréglée à 37°C. Le couvercle maintient une température homogène à l'intérieur de l'appareil. Les échantillons pour différentes analyses sont chauffés à une température constante avec une précision de $\pm 0,5$.

Utilisation

Le bain-marie de sérologie a été utilisé pour des travaux pratiques dans les laboratoires de biologie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.

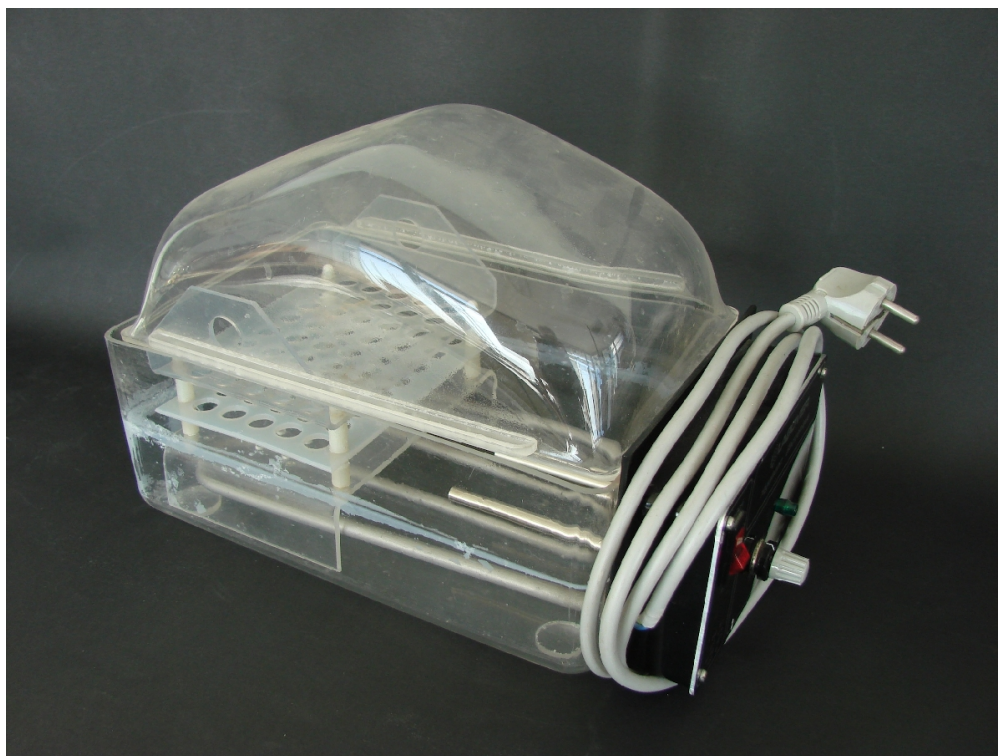

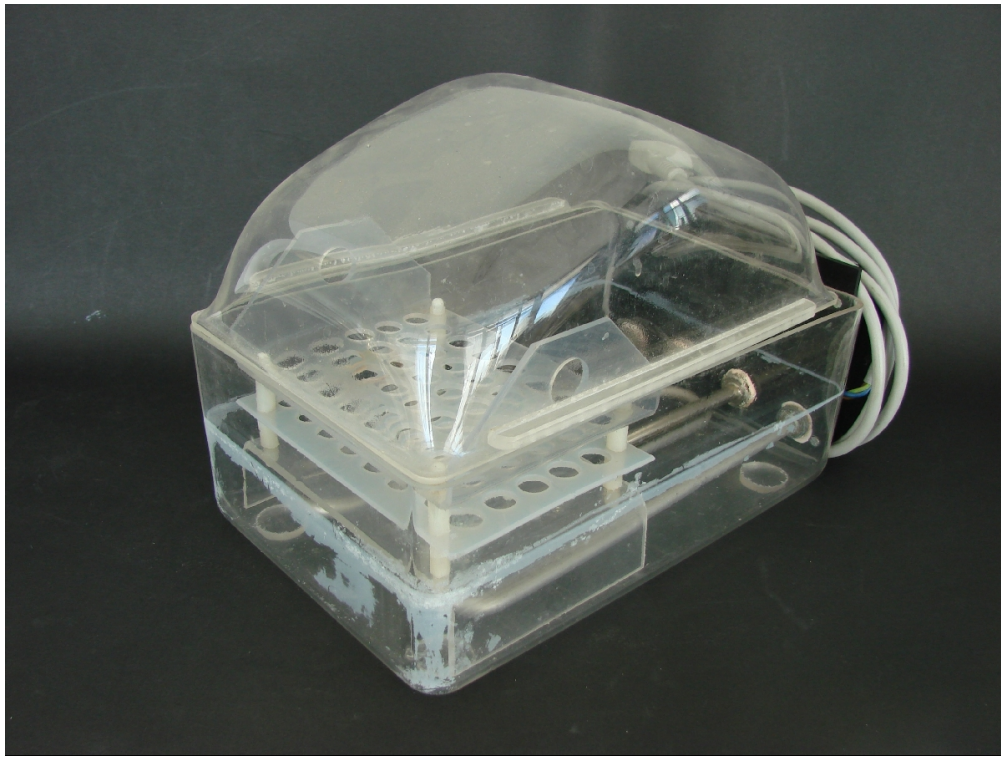



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain-marie de sérologie (LABOVER),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4927>, consulté le 2026-07-24