

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ADAPTATEUR POUR THERMOMÈTRE SUR CUVE

FICHE N° 31376

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : LPM

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de l'Ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : CX-53

Matériaux : Acier, Plastique




Description

L'adaptateur de thermomètre sur cuve comprend deux petites plaques en plastique qui se positionneront de part et d'autre du bord d'une cuve en verre. Entre les deux, une molette montée sur une vis, permet de modifier l'écartement. Une autre molette, placée à l'extérieur permet de serrer le dispositif sur le bord de la cuve. Sur la plaque à l'intérieur de la cuve, se fixe une petite pince à trois doigts, formant ressort, qui maintiendra un thermomètre de contrôle. Trois pinces présentant des écartements différents, sont disponibles.


Utilisation

L'adaptateur de thermomètre sur cuve a été utilisé pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.



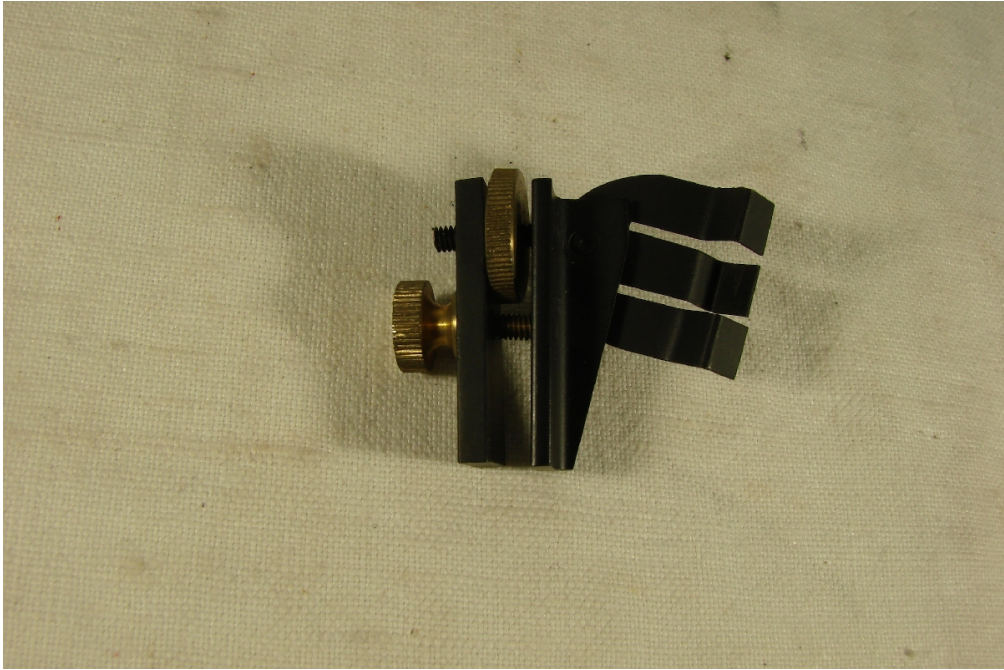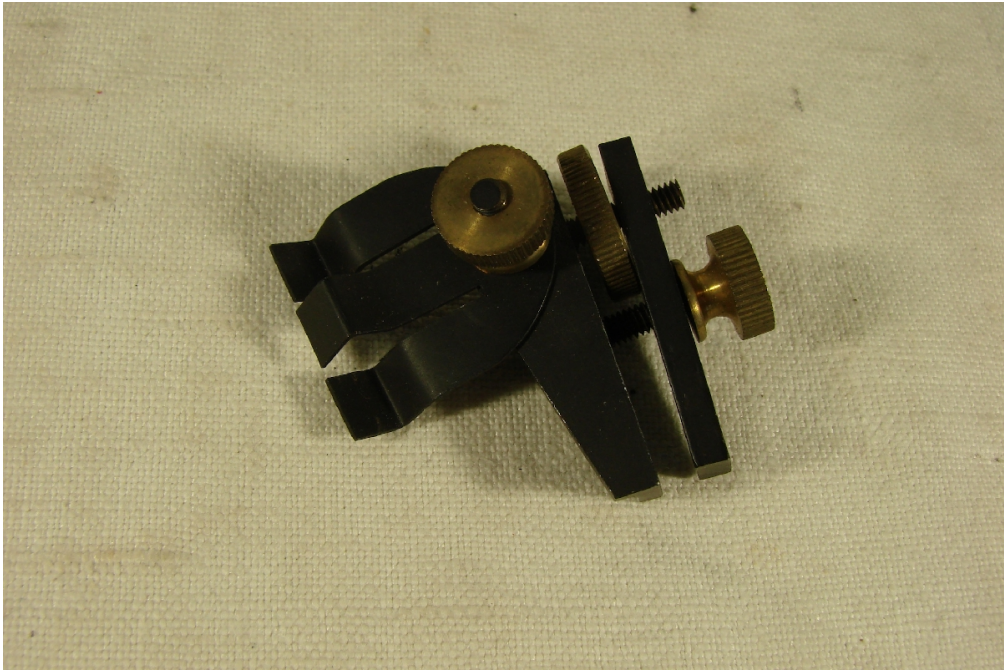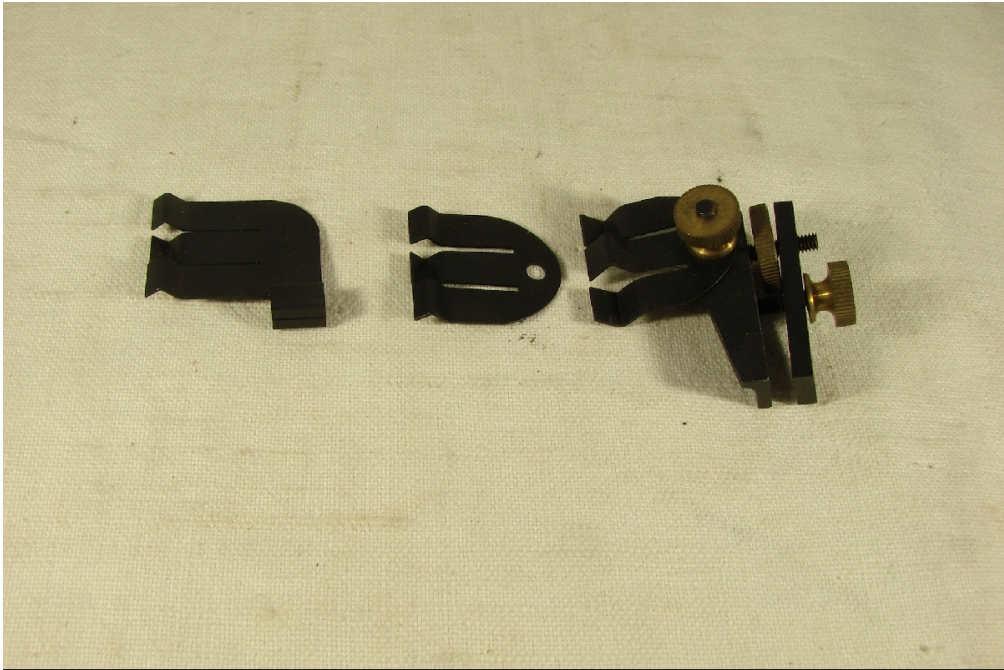




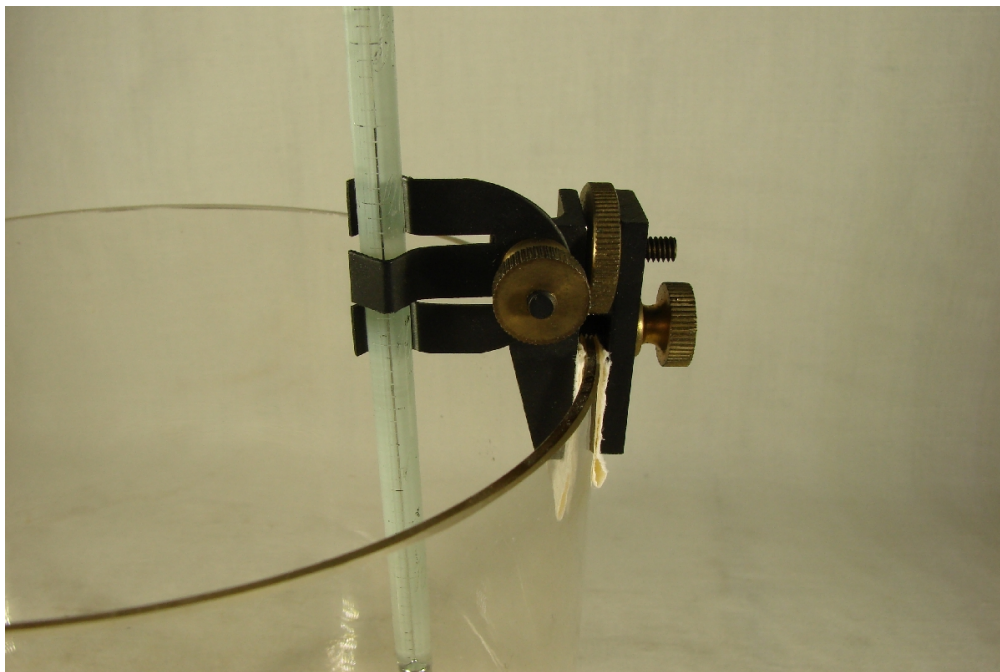

MARQUE et MODELE



DEPOSES

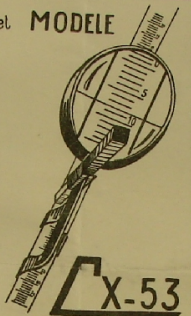

X-53

La LPM Cx53

par sa précision, sa mania-
bilité, la facilité avec laquelle
chacun peut l'adapter, grâce
à ses deux pinces à de
multiples diamètres de tige,
représente l'instrument que
l'on attendait dans tous les
laboratoires.

En outre, la pince de cuve
réglable permet une adap-
tation facile et orientable qui place la **LPM Cx53** au
sommet de la technique moderne de laboratoire.

Plus d'erreurs
Plus de perte de temps
Plus de vue fatiguée

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Adaptateur pour thermomètre sur cuve (LPM), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=5020>, consulté le 2026-07-24