

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SERINGUE À AIGUILLE FIXE SGE

FICHE N° 31408

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : SGE

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : 50 μ L

Matériaux : Verre, Acier inoxydable


Description


Cette seringue à aiguille fixe est constituée d'un corps en verre dans lequel coulisse un piston en acier. L'aiguille est soudée à la seringue par une colle époxy. L'embout de l'aiguille est carré à 90° pour une utilisation en chromatographie CPG ou HPLC. Le corps de la seringue est gradué de 0 à 50 microlitres avec une précision de 1 microlitre. L'aiguille permet la perforation de la pastille qui ferme l'injecteur du chromatographe. Elle se range dans une boîte en carton munie d'une forme en polystyrène.

Utilisation

La seringue à aiguille fixe a été utilisée pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.



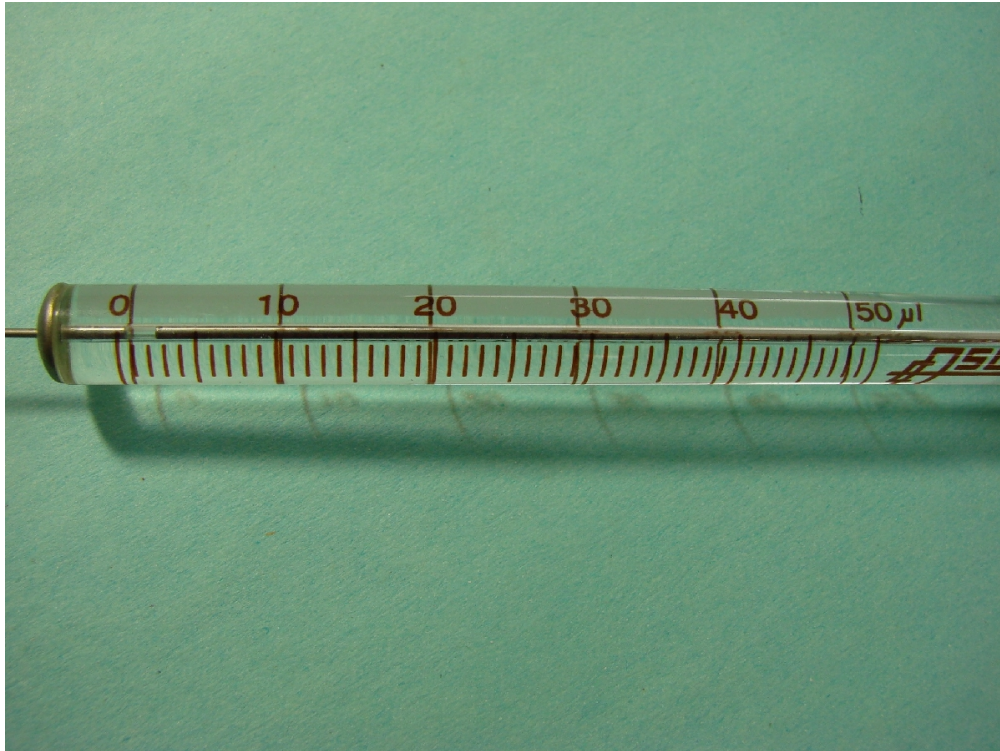

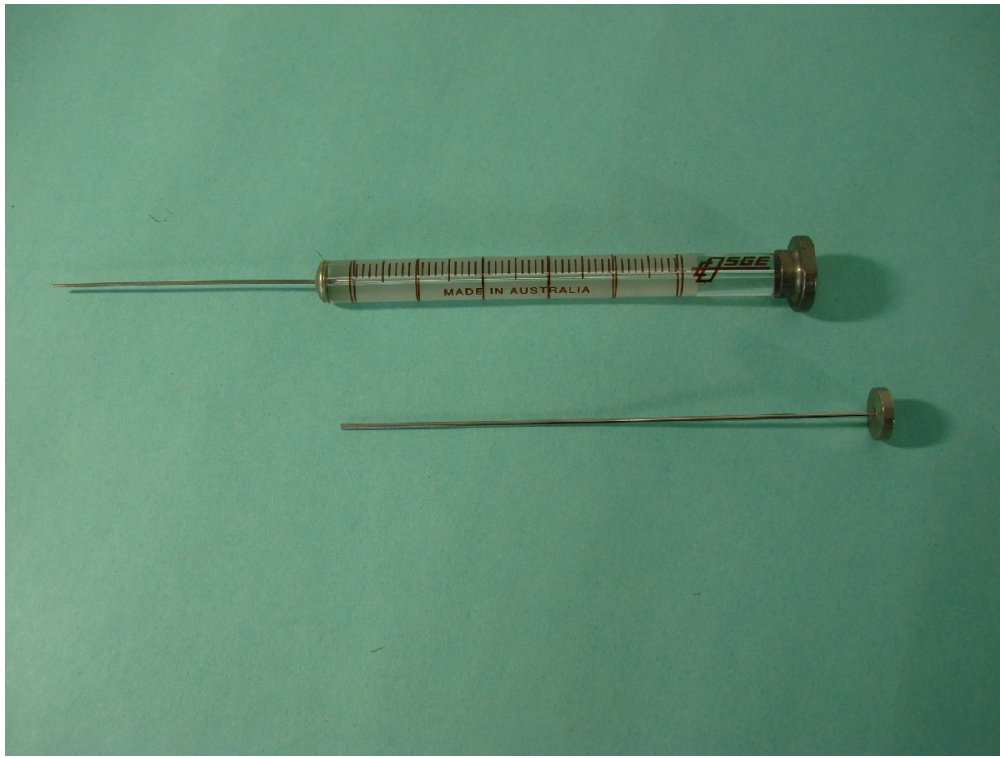

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringue à aiguille fixe SGE (SGE), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=5052>, consulté le 2026-07-24