

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AGITATEUR MAGNÉTIQUE NUOVA II S33420

FICHE N° 5919

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Bioblock Scientific

Domaines : Biologie, Chimie

Sous-domaines : Biologie végétale, Biochimie, Biochimie

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier

Ville : Toulouse

Modèle : S33420

Matériaux :


Description

L'agitateur magnétique Nuova II Bioblock Scientific permet d'homogénéiser un mélange. Le moteur électrique dont la vitesse est réglée électroniquement entraîne la rotation d'un barreau aimanté aussi appelé «turbulent» placé dans la solution à mélanger. La vitesse de rotation varie généralement de 60 à 1200 tours/minute.

Utilisation

Cet instrument était utilisé au LRSV de l'Université Paul Sabatier à la fin du XXe siècle pour mélanger des solutions et pour la préparation de solutions salines.



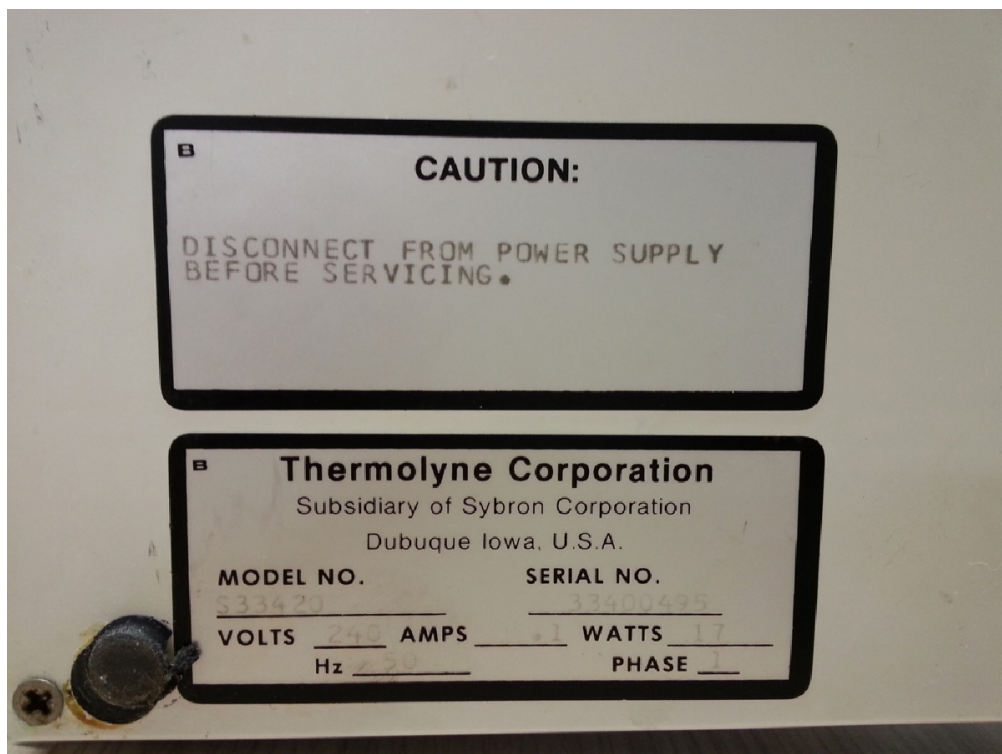

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Agitateur magnétique Nuova II S33420 (Bioblock Scientific), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=9103>, consulté le 2026-07-25