

LOT DE PIPETTES SÉROLOGIQUES JETABLES

FICHE N° 6646

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Pyrex USA

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie animale

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS)

Ville : Toulouse

Modèle :


Matériaux : Verre Pyrex, marque déposée


Description

Ces pipettes sérologiques jetables Pyrex sont utilisées pour le prélèvement et la distribution d'un volume connu de liquide. Elles sont en verre borosilicaté Pyrex avec pour certaines une ouverture bouchée par un coton cardé. Leur contenance varie de 5 à 10 ml. Les graduations permettent de prélever un volume précis d'une solution. Pour cela, les chercheurs aspirent, avec un auxiliaire de pipetage, le liquide jusqu'au trait de jauge souhaité. Puis, ils laissent couler le liquide dans le contenant souhaité. Les pipettes possèdent aussi des graduations négatives pour permettre d'étendre le volume de pipetage possible si besoin. Ces pipettes sont à usage unique.

Utilisation

Ces pipettes étaient utilisées lors de recherches en biologie animale, effectuées dans plusieurs laboratoires de l'Université Paul Sabatier de Toulouse qui ont coexisté entre les années 1950 et 2000. Elles étaient encore utilisées au début des années 2000 par le Centre de Recherches sur la Cognition Animale, héritier de ces divers laboratoires.

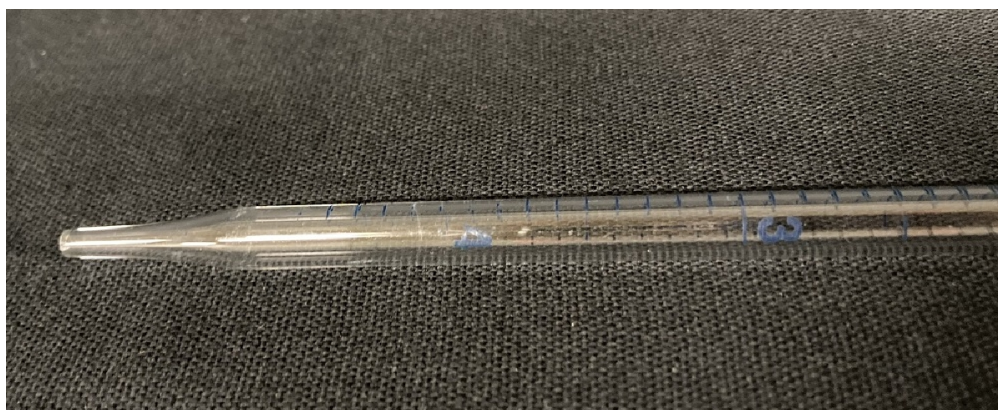

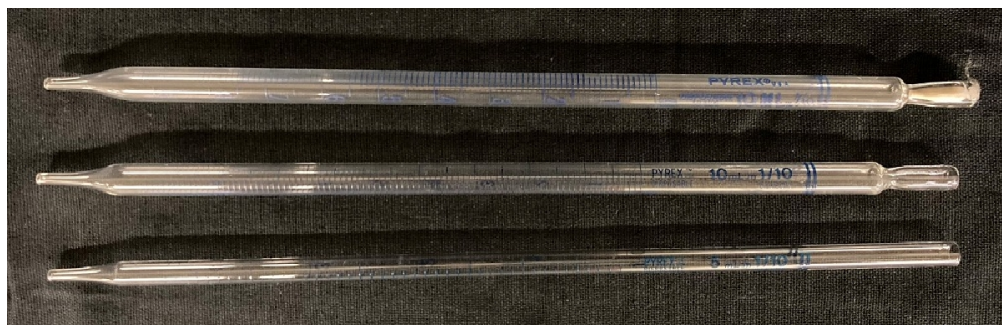

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lot de pipettes sérologiques jetables (Pyrex USA), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=9830>, consulté le 2026-07-25